

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



GROUP SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION GROUPEE DE SÉCURITÉ

**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –
Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment**

**Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire –
Partie 2-011: Exigences particulières pour appareils de réfrigération**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 61010-2-011

Edition 1.0 2016-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



GROUP SAFETY PUBLICATION
PUBLICATION GROUPEE DE SÉCURITÉ

**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use –
Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment**

**Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire –
Partie 2-011: Exigences particulières pour appareils de réfrigération**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 19.080

ISBN 978-2-8322-3505-8

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope and object.....	9
2 Normative references.....	10
3 Terms and definitions	10
4 Tests.....	11
5 Marking and documentation	13
6 Protection against electric shock.....	17
7 Protection against mechanical HAZARDS.....	17
8 Resistance to mechanical stresses.....	17
9 Protection against the spread of fire	17
10 Equipment temperature limits and resistance to heat.....	18
11 Protection against HAZARDS from fluids.....	19
12 Protection against radiation, including laser sources, and against sonic and ultrasonic pressure	29
13 Protection against liberated gases and substances, explosion and implosion	29
14 Components and subassemblies.....	30
15 Protection by safety interlocks	30
16 HAZARDS resulting from application.....	30
17 RISK assessment	31
Annexes	32
Annex G (informative) Leakage and rupture from fluids under pressure.....	32
Annex L (informative) Index of defined terms.....	32
Annex AA (normative) Non-sparking “n” electrical apparatus.....	33
Annex BB (informative) HAZARDS associated with REFRIGERATING SYSTEMS and refrigerants.....	34
Annex CC (informative) Safety requirements for components and piping.....	36
Annex DD (informative) Equipment containing FLAMMABLE REFRIGERANTS Information and marking requirements.....	41
Bibliography	44
Figure 101 – Schema of a REFRIGERATING SYSTEM incorporating a condenser	7
Figure 102 – Flow chart illustrating the selection process	8
Figure 103 – Scratching TOOL tip details	25
Table 1 – Symbols	15
Table 101 – Maximum temperatures for motor-compressors	18
Table 102 – Minimum temperature for determination of saturated vapor pressure of refrigerant.....	20
Table 103 – Refrigerant flammability parameters	28
Table CC.1 – Parameters of pressure vessels according to EN 14276-1.....	36
Table CC.2 – Parameters of pipping according to EN 14276-2	38
Table CC.3 – Component and piping requirements	39

Table CC.4 – Minimum wall thickness for copper and steel tubing.....40
Table DD.1 – Quantity of Group A2/A3 refrigerant per occupied space.....43

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE –**

Part 2-011: Particular requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61010-2-011 has been prepared by IEC technical committee 66: Safety of measuring, control and laboratory equipment.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
66/589/FDIS	66/598/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61010 series, under the general title, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use*, may be found on the IEC website.

IEC 61010-2-011 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 61010-1. It was established on the basis of the third edition (2010) of IEC 61010-1.

This Part 2-011 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 61010-1 so as to convert that publication into the IEC standard: *Particular requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT*.

Where a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this Part 2, that subclause applies as far as is reasonable. Where this part states “addition”, “modification”, “replacement”, or “deletion”, the relevant requirement, test specification, or note in Part 1 should be adapted accordingly.

In this standard:

- 1) the following print types are used:
 - requirements and definitions: in roman type;
 - NOTES: in smaller roman type;
 - *conformity and tests: in italic type*;
 - terms used throughout this standard which have been defined in Clause 3: SMALL ROMAN CAPITALS.
- 2) subclauses, figures, tables and notes which are additional to those in Part 1 are numbered starting from 101. Additional annexes are lettered starting from AA.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This standard, in conjunction with Part 2-010 and Part 2-012, addresses the specific HAZARDS associated with the heating and cooling of materials by equipment which are segregated as follows:

IEC 61010-2-010	specifically addresses the HAZARDS associated with equipment incorporating heating systems.
IEC 61010-2-011	specifically addresses the HAZARDS associated with equipment incorporating REFRIGERATING SYSTEMS.
IEC 61010-2-012	specifically addresses the HAZARDS associated with equipment incorporating both heating and REFRIGERATING SYSTEMS that interact with each other such that the combined heating and cooling system yield additional or more severe HAZARDS for the two systems than if treated separately. It also addresses the HAZARDS associated with the treatment of materials by other factors like irradiation, excessive humidity, CO ₂ and mechanical movement.

Guidance for the application of the correct Part 2 standard(s)

When the equipment includes only a material heating system, and no REFRIGERATING SYSTEM or other environmental factors apply, then Part 2-010 applies without needing Part 2-011 or Part 2-012. Similarly, when the equipment includes only a REFRIGERATING SYSTEM, and no material heating system or other environmental factors apply, then Part 2-011 applies without needing Part 2-010 or Part 2-012. However, when the equipment incorporates both a material heating system, and a REFRIGERATING SYSTEM or the materials being treated in the intended application introduce significant heat into the REFRIGERATING SYSTEM, a determination should be made whether the interaction between the two systems will generate additional or more severe HAZARDS than if the systems were evaluated separately (application temperature, see flow chart for selection process). If the interaction of the heating and cooling functions yields no additional or more severe HAZARDS then both Part 2-010 and Part 2-011 apply for their respective functions. Conversely, if additional or more severe HAZARDS results from the combining of the heating and cooling function, or the equipment incorporates additional material treatment factors then Part 2-012 applies but not Part 2-010 or Part 2-011.

What HAZARDS are applicable for a REFRIGERATING SYSTEM?

The typical HAZARDS for a REFRIGERATING SYSTEM (see Figure 101) consisting of a motor-compressor, a condenser, an expansion device and an evaporator include but are not limited to:

- The excess of temperature of the low-pressure side (return temperature) to the motor-compressor is higher than admissible. A motor-compressor incorporates a refrigerant cooled motor and it should be established that the maximum temperatures of low-pressure side under least favorable condition do not exceed the insulation RATINGS within the motor.
- The excess of pressure of the low-pressure side at the inlet to the motor-compressor is higher than admissible. The housing of the motor-compressor is exposed to this pressure and so the design RATING of the motor-compressor housing should accommodate the worst case pressures whilst providing the correct safety margin for a pressure vessel.
- The excess of temperature of the high-pressure side to the condenser is higher than admissible. The temperatures of the high-pressure side under the most unfavorable conditions may present a temperature HAZARD if the OPERATOR is exposed, or an electrical HAZARD if insulation is degraded.

- The excess of pressure of the high-pressure side to the condenser is higher than admissible. The refrigerant components downstream of the motor-compressor up to the expansion device are exposed to this pressure and so the design RATING of these components should accommodate the worst case pressures whilst providing the correct safety margin for a pressure vessel.
- The maximum application temperatures, where the heat is being extracted from, may impact the maximum temperature of the low-pressure side to the motor-compressor as well as present a temperature HAZARD if the OPERATOR is exposed, or an electrical HAZARD if insulation is degraded. Whether this application temperature is derived from an integral heating function of the device or from the heat dissipated from the material being cooled, the impact under worst case conditions should be evaluated.
- The current draw of the equipment should be established when including the worst case running conditions of the REFRIGERATING SYSTEM including any defrost cycles that may apply.

The worst case conditions should be determined for the equipment and will include both the least favorable NORMAL USE conditions as well as the most unfavorable testing results under SINGLE FAULT CONDITIONS.


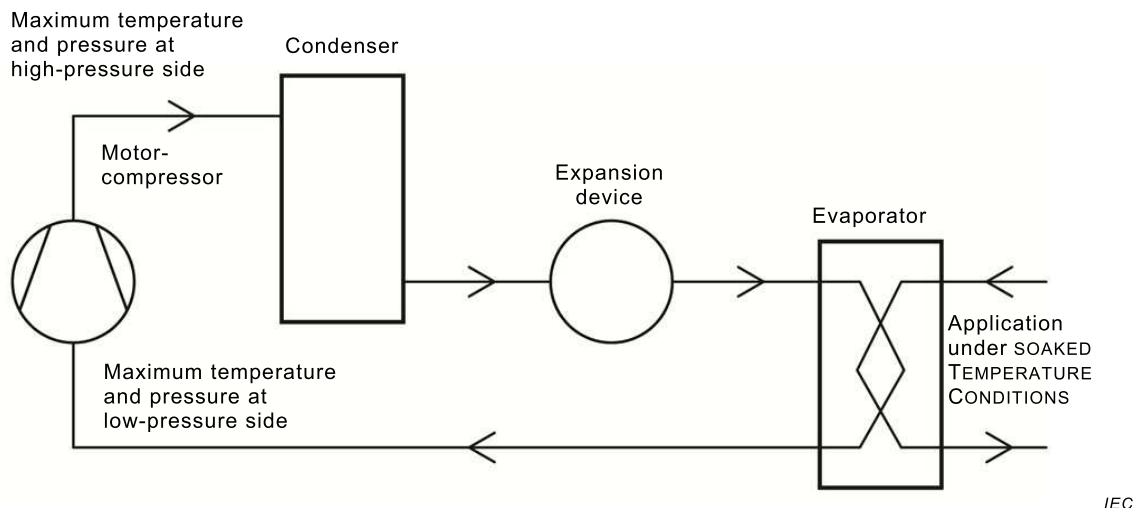


Figure 101 – Schema of a REFRIGERATING SYSTEM incorporating a condenser

The selection process is illustrated in the following flow chart (see Figure 102).

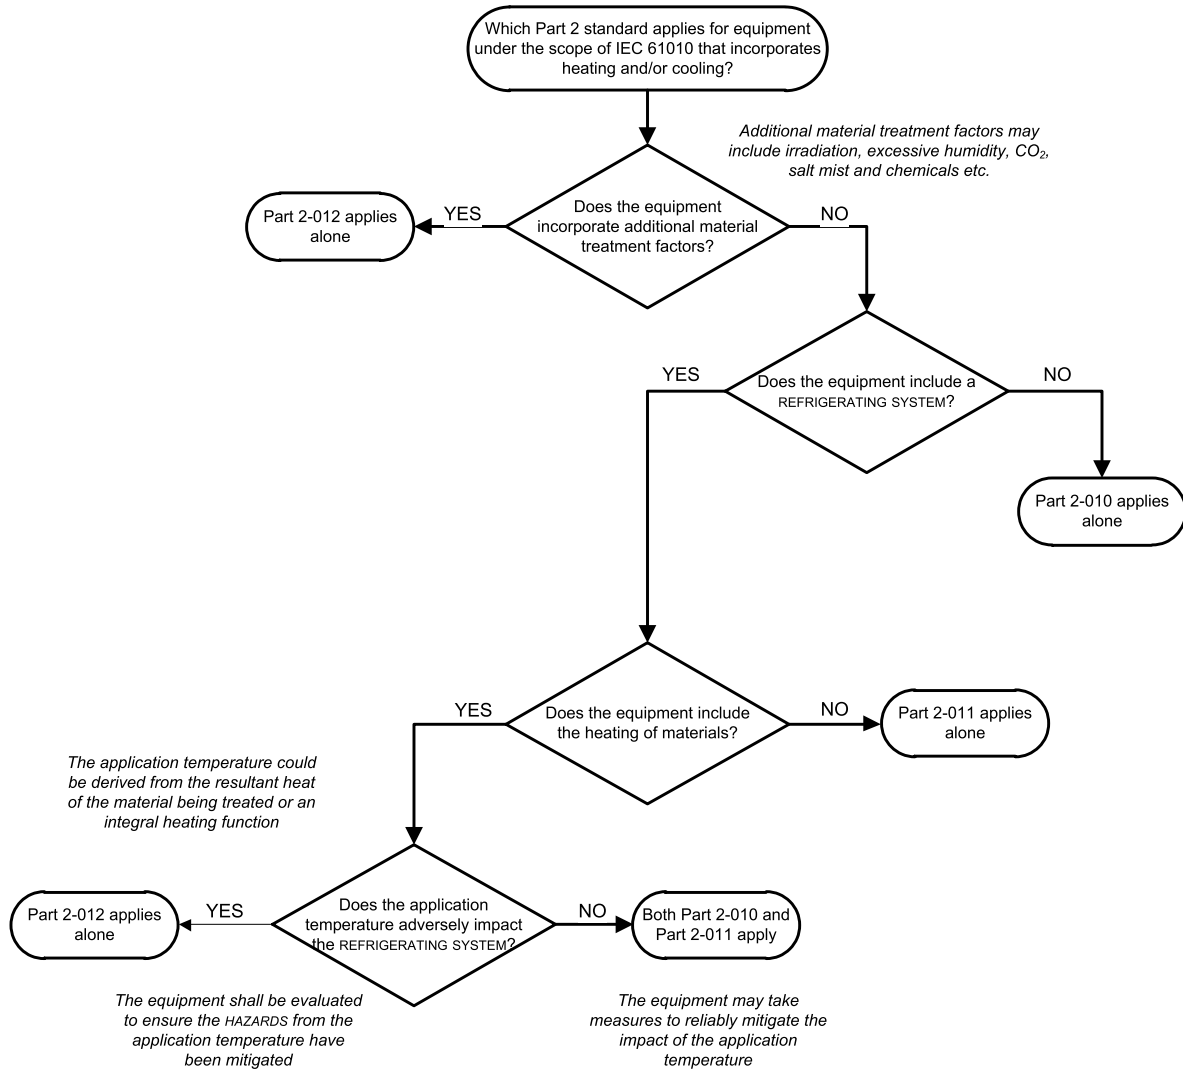

IEC

Figure 102 – Flow chart illustrating the selection process

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE –

Part 2-011: Particular requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT

1 Scope and object

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

1.1.1 Equipment included in the scope

Replacement:

Replace the first paragraph by the following:

This group safety publication is primarily intended to be used as a product safety standard for the products mentioned in the scope, but shall also be used by technical committees in the preparation of their publications for products similar to those mentioned in the scope of this standard, in accordance with the principles laid down in IEC guide 104 and ISO/IEC Guide 51.

This Part 2 of IEC 61010 specifies particular safety requirements for the following types a) to c) of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used, whenever that equipment incorporates REFRIGERATING SYSTEMS whether an integral part of, or remote to the equipment and the equipment is in direct control of the REFRIGERATING SYSTEM.

This Part 2 details all the requirements when up to 150 g of FLAMMABLE REFRIGERANT are used per stage of a REFRIGERATING SYSTEM. Additional requirements beyond the current scope of this standard apply if a refrigerant charge of FLAMMABLE REFRIGERANT exceeds this amount.

Addition:

Add the following text after the last paragraph:

NOTE 101 Examples for REFRIGERATING EQUIPMENT include, but are not limited to, laboratory equipment such as laboratory refrigerators, freezers, refrigerated display cabinets, etc.

If all or part of the equipment falls within the scope of one or more other Part 2 standards of IEC 61010 as well as within the scope of this standard, it should also meet the requirement of those other Part 2 standards, In particular, if equipment is intended to be used as a centrifuge, it should meet the requirements of IEC 61010-2-020. However, when the equipment incorporates a REFRIGERATING SYSTEM and a heating function where the combination of the two introduces additional or more severe HAZARDS than if treated separately then the application of IEC 61010-2-012 should be considered instead of this Part 2.

See further information in the flow chart for the selection process and guidance in the Introduction.

1.1.2 Equipment excluded from scope

Addition:

Add the following new item after item j):

aa) equipment incorporating transcritical refrigerant system (system that use CO₂) or system that use ammonia (NH₃) as the refrigerant.

1.2 Object

1.2.1 Aspects included in scope

Replacement:

Replace the first paragraph by the following:

The object of this Part 2 is to assure that the design and methods of construction of REFRIGERATING EQUIPMENT provide adequate protection for OPERATORS, bystanders, trained service personnel, and the surrounding area against the specific HAZARDS that relate to REFRIGERATING SYSTEMS.

Addition:

Add the following note after the existing note:

NOTE 101 A list of HAZARDS typically associated with REFRIGERATING SYSTEM and refrigerants is included in Annex BB.

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following references to the list:

IEC 60079-15:2010, *Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection “n”*

IEC 60335-2-34:2012, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors*
IEC 60335-2-34:2012/AMD1:2015

UL 471:2010, *Commercial Refrigerators and Freezers*

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following terms and definitions:

3.101

REFRIGERATING EQUIPMENT

test, measurement, control or laboratory equipment that incorporates a REFRIGERATING SYSTEM either as an integral part of or remote to the equipment

3.102

REFRIGERATING SYSTEM

factory assembled unit for performing part of the refrigerant cycle (compression and condensation) comprising one or more refrigerant compressors with motors, condensers, liquid receivers (where required), interconnecting pipe work and ancillary equipment

3.103**FLAMMABLE REFRIGERANT**

refrigerant with a flammability classification of group 2 or 3 in accordance with ISO 5149-1 and ISO 817

Note 1 to entry: For refrigerant blends which have more than one flammability classification, either the most unfavourable classification is taken for the purpose of this definition or the blend itself is evaluated for flammability in accordance with ISO 817.

3.104**HPCO****HIGH PRESSURE CUT-OUT)**

pressure actuated device that is designed to stop the operation of the pressure generator

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.105**PS**

maximum allowable pressure as determined by the collated test results detailed in 11.7

3.106**SOAKED TEMPERATURE CONDITION**

environmental temperature condition when all the temperatures in the equipment under test (EUT) equal to ± 2 °C of the test room ambient

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.107**ABNORMAL OPERATION**

operation of a REFRIGERATING SYSTEM with a limited RATED ambient temperature range in ambient temperature conditions outside that limitation but within the temperature limits of 1.4.1

4 Tests

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

4.3 Reference test conditions**4.3.1 Environmental conditions**

Addition:

Add the following text after d):

Since the operating temperatures, pressures and current draw for a REFRIGERATING SYSTEM are significantly impacted by ambient temperatures in a non-linear way, linear extrapolation of test data is not possible. Therefore tests to establish temperatures, pressures, and current draw of a REFRIGERATING SYSTEM shall be conducted under the following environmental conditions:

- aa) a temperature of 40 °C;
- bb) a relative humidity not exceeding the limits of 1.4.1 d);

If the equipment is RATED by the manufacturer to operate in extended environmental conditions as defined by 1.4.2 or a more restricted environment condition in accordance with 1.4.1 note 2, then these conditions will define the settings for 4.3.1 aa) or 4.3.1 bb).

When the REFRIGERATING SYSTEM is water cooled, the temperature of the water supply shall be the maximum as specified by the manufacturer (see 5.4.3) with the worst case water pressure as specified by the manufacturer.

If a restricted environment condition in accordance with 1.4.1, note 2, is employed then the test of 4.4.2.101 applies.

4.3.2 State of equipment

4.3.2.1 General

Addition:

Add the following after the first paragraph:

When measuring temperatures, pressures and current draws of equipment incorporating REFRIGERATING SYSTEM the tests shall be started from a SOAKED TEMPERATURE CONDITION when all pressures have fully equalized. Tests at the extremes of the input voltage ($\pm 10\%$) shall start under these voltage conditions and achieve a stable state but need not start from a SOAKED TEMPERATURE CONDITION. Safety protective devices shall not operate during this test.

4.4.2 Application of fault conditions

4.4.2.10 Cooling

Replacement:

Replace the text with the following:

For cooling not associated with the cooling of the REFRIGERATING SYSTEM:

- a) air-holes with filters shall be closed;
- b) forced cooling by motor-driven fans shall be stopped;
- c) cooling by circulation of water or other coolant shall be stopped.

For cooling associated with the cooling of the REFRIGERATING SYSTEM:

- d) condenser fan stall test – for an air cooled REFRIGERATING SYSTEM

Each condenser fan shall be stalled one at a time unless a single fault could disable all condenser fans simultaneously. The temperatures and pressures shall be monitored at short intervals throughout the test for the pressures to ensure that that peak pressures are captured. This test is conducted at a room ambient of $25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$.

- e) condenser water failure test – for a water cooled REFRIGERATING SYSTEM

The REFRIGERATING SYSTEM is to be operated with the condensing water shut off and also with the condensing water restricted until maximum stabilized temperatures are attained or until representative maximum temperatures are attained under cycling load. The temperatures and pressures shall be monitored at short intervals throughout the test for the pressures to ensure that that peak pressures are captured. This test is conducted at a room ambient of $25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$.

- f) Condenser fins shall be blocked to simulate clogging with dust etc.

If a manual reset HPCO is relied upon to limit the peak pressure during tests d), e) or f), then it shall be reset manually within 6 seconds of operation for 10 cycles.

If an automatic reset HPCO is relied upon to limit the peak pressure during tests d), e) or f), then it shall be permitted to cycle automatically until it can be demonstrated that peak temperatures and pressures have been achieved.

If it can be demonstrated that an HPCO will operate during tests d), e) or f), the manufacturer may elect to waive this test, but will set the PS for the high and low side of the motor-compressor to the rating of the HPCO.

For units with both air-cooled and water-cooled condensers – only one can be faulted at a time unless the customer is permitted to run either air-cooled or water-cooled (the design incorporates a redundant cooling option for the condenser).

For a cascade REFRIGERATING SYSTEM, if a heat exchanger from the first stage system acts as a condenser to the second stage system, then the manufacturer may elect to run each condenser stage individually under the tests of d), e) or f) accordingly. In this case disabling the first stage system is considered to simulate the second stage running under a stalled fan or condenser water failure test.

Addition:

Add the following new subclauses:

4.4.2.101 Extreme operating ambient abnormal (ABNORMAL OPERATION)

For REFRIGERATING EQUIPMENT intended to operate in a restricted environment and tested in accordance with 4.3.1 then this additional test of ABNORMAL OPERATION shall apply to simulate the failure of the controlled environment in the installation.

Having determined the worst case test condition for the temperature and pressure tests under 10.4.1 the unit is run under these conditions until a steady state has been achieved. The test environment is then increased to the limits from 1.4.1 for Normal environmental conditions (40 °C, up to 50 % RH) and the unit is allowed to stabilize and the maximum temperatures and pressures are recorded. The operation of protective devices is permitted during this test. If steady state conditions are not possible due to the operation of protective devices then the maximum values recorded for this test shall be either:

- the maximum temperatures and pressures at the point of operation of non-resettable or manually resettable device. The manually resettable device does not need to be reset during this test; or
- the maximum temperatures and pressures achieved after the cycling of auto-resetting protective devices. Cycling shall continue until it is clear that successive cycles will not develop higher maximum values.

4.4.2.102 Uncontrolled cooling test

Temperature controllers shall be overridden to produce uncontrolled cooling. This applies whether the controller controls the temperature of the equipment, heat transfer medium or material being processed.

4.4.3.1 General

Addition:

Add a second new paragraph:

Due to the time it may take to achieve stable conditions for a REFRIGERATING SYSTEM, the duration of single fault tests may be longer than 4 h unless it is clear that stable conditions have been maintained for at least 1 h.

5 Marking and documentation

This clause of part 1 is applicable, except as follows:

5.1.2 Identification

Addition:

Add the following new items after the note following item b):

- aa) the total mass of refrigerant for each separate refrigerant circuit;
- bb) for a single component refrigerant, at least one of the following:
 - the chemical name,
 - the chemical formula,
 - the refrigerant number;
- cc) for a blended refrigerant, at least one of the following:
 - the chemical name and nominal proportion of each of its components,
 - the chemical formula and nominal proportion of each of its components,
 - the refrigerant number and nominal proportion of each of its components,
 - the refrigerant number of the refrigerant blend;

NOTE 101 Refrigerant numbers are quoted in accordance with ISO 817 or other refrigerant classification standard, e.g. ANSI/ASHRAE 34.

- dd) maximum allowable pressure (PS), high and low sides for each refrigerant stage;

NOTE 102 The collation of the test results that define PS is detailed in 11.7.101.

5.1.3 MAINS supply

Replacement:





Replace the conformity statement as follows:

Conformity is checked by inspection and by measurement of power or input current to check the marking of 5.1.3 c). The measurement is made with the equipment in the condition of maximum power consumption, but to exclude any initial inrush current it is not made until the current has stabilized (usually after 1 min). Transients are ignored. For REFRIGERATING EQUIPMENT, the impact of extreme ambient temperatures and the interaction of any defrost mode need to be evaluated in determining the condition of maximum power consumption.

Addition:

Add the following new symbols to Table 1:

Table 1 – Symbols

Number	Symbol	Reference	Description
101		ISO 7010 – W010 (2011-06)	Warning; low temperature/freezing conditions, frostbite HAZARD (MOD)
102		ISO 7010 – W021 (2011-06)	Warning; flammable material
103		ISO 7010-W011	Warning; slippery surface
104		ISO 7010-W024	Warning; crushing of hands

5.2 Warning markings

Replacement:

Replace the first paragraph with the following:

Warning markings specified in this standard shall meet the following requirements.

Replace a) by the following:

- a) the perpendicular height of the triangle for all warning symbols shall be at least 15 mm. The height of text shall be at least 1,8 mm, depending on the size of the equipment, the legibility during NORMAL USE and the space available for the symbol. Symbols and text shall have clear contrast in colour with the background.

Addition:

Add the following new paragraph after the last paragraph (before the conformity statement);

Warning markings or symbol for particular HAZARDS, which exist or develop only when performing installation or maintenance of the equipment, shall be marked and visible only when executing this particular maintenance. For example, the marking of the type of FLAMMABLE REFRIGERANT and of the flammable insulation blowing gas, shall be visible when gaining access to the motor-compressors, and, in the case of equipment with a remote refrigerant condensing unit, the pipe connections. The symbol 102 of Table 1 shall be placed on the nameplate of the unit near the declaration of the refrigerant type and charge information. It shall be visible after installation of the REFRIGERATING EQUIPMENT.

5.4 Documentation

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

5.4.1 General

Replacement:

Replace item d) by:

d) the information specified in 5.4.2 to 5.4.6, 5.4.101 and 5.4.102;

5.4.3 Equipment Installation

Replacement:

Replace the note with the following text

NOTE 1 It is recommended to add a statement in the documentation for the installation that the safety of any system incorporating the equipment is the responsibility of the assembler of the system.

NOTE 2 For the US, equipment containing flammable refrigerant is required to have additional instructions – see informative Annex DD.

5.4.4 Equipment operation

Addition:

Add the following new item after 5.4.4 j):

aa) information to allow safe access during use including identification of trip and slip HAZARDS (see also 7.3.101 and 16.101).

Addition:

Add the following subclauses:

5.4.101 Additional instructions for equipment with a separate REFRIGERANT CONDENSING UNIT and intended for connection to a water supply

For equipment with a separate refrigerant condensing unit, the instructions shall include a statement containing the substance of the following:

The installation of the REFRIGERATING EQUIPMENT and the refrigerant condensing unit shall only be made by the manufacturer's service personnel or similarly skilled person.

The information provided with REFRIGERATING EQUIPMENT with a separate REFRIGERANT CONDENSING UNIT shall include

- information on the type of separate REFRIGERANT CONDENSING UNIT to which the cabinet shall be connected;
- an electrical diagram showing the electrical terminals for connections.

For equipment intended for connection to a water supply for cooling purposes, the instructions shall contain information on the maximum permitted temperature and maximum and minimum pressure of the inlet water consistent with safe operation of the appliance.

5.4.102 Additional instructions for equipment that use FLAMMABLE REFRIGERANT

For equipment that use FLAMMABLE REFRIGERANT, the instructions shall include information pertaining to the handling, servicing and disposal of the equipment.

The instructions for equipment which use FLAMMABLE REFRIGERANT shall include the substance of the following warnings as necessary:

- **WARNING:** Keep all ventilation openings in the enclosure or, in the structure for building-in, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

For equipment which use flammable insulation blowing gases, the instructions shall include information regarding disposal of the equipment.

The instructions for split-systems that use a **FLAMMABLE REFRIGERANT** shall include the substance of the following warning:

- **WARNING:** In order to reduce flammability **HAZARDS** the installation of this equipment shall only be carried out by a suitably qualified person.

6 Protection against electric shock

This clause of Part 1 is applicable.

7 Protection against mechanical HAZARDS

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

7.3 Moving parts

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following new subclause:

7.3.101 Door closure/locking mechanisms

For door latching or locking devices with or without self-locking mechanisms, where careless operation may cause crushing **HAZARDS** of hand or fingers, the symbol 104 of Table 1 shall be marked on the location or part where the **HAZARD** may occur, warning of motion of mechanical parts and against **HAZARD** of crushing.

Conformity is checked by inspection.

8 Resistance to mechanical stresses

This clause of Part 1 is applicable.

9 Protection against the spread of fire

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following new subclause:

9.5.101 Warnings requirements for flammable liquids

If **FLAMMABLE REFRIGERANT**, **FLAMMABLE REFRIGERANT** blends and/or flammable insulation blowing gases are used, the equipment shall be marked with symbol 102 of Table 1. Additional explanations for the warning symbol shall be detailed in the documentation for **OPERATOR**, service personnel and **RESPONSIBLE BODY** for final disposal of the equipment,

including warnings of the flammable materials and against HAZARDS of fire and/or explosion (see 5.4.102).

In other cases where flammable material is present in the equipment, symbol 102 can be used as a warning marking.

10 Equipment temperature limits and resistance to heat

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

10.1 Surface temperature limits for protection against burns

Replacement:

Replace the second paragraph by the following second paragraph:

If easily touched heated surfaces are necessary for functional reasons, whether because they are intended to deliver heat or are hot because of proximity to heating parts, they are permitted to exceed the values of Table 19 in NORMAL CONDITION and to exceed 105 °C in SINGLE FAULT CONDITION, provided that they are recognizable as such by appearance or function or are marked with symbol 13 of Table 1 (see 5.2).

10.2 Temperature of windings

Addition:

Add the following text and table below Table 20:

Conformity for motor-compressors is checked by measurement as specified in 10.4, in NORMAL CONDITION and in the applicable SINGLE FAULT CONDITIONS of 4.4.2.10 and 4.4.2.101 and also in any other SINGLE FAULT CONDITIONS that could cause a HAZARD as a result of excessive temperature or pressure. The temperature limits for motor-compressors are defined by Table 101. The pressures are recorded for use in 11.7.2.

For motor-compressors conforming with IEC 60335-2-34:2012 and IEC 60335-2-34:2012/AMD1:2015 (including its Annex AA), compressor housing and winding temperatures are not measured. For motor-compressors not conforming with these requirements, then the temperature test methods detailed in IEC 60335-2-34 shall be employed to measure the winding temperatures.

Table 101 – Maximum temperatures for motor-compressors

Part of the motor-compressor	Temperature (°C)
Windings with	
– synthetic insulation	140 °C
– cellulosic insulation or the like	130 °C
Housing	150 °C

10.3 Other temperature measurements

Addition:

Add the following new item after 10.3 e):

- aa) The temperature of components of the REFRIGERATING SYSTEM to establish maximum pressures (see 11.7.101).

10.4 Conduct of temperature tests

10.4.1 General

Replacement:

Replace the text with the following:

Maximum temperature is determined by measuring the temperature rise under reference test conditions defined by 4.3.1 of this standard. Linear extrapolation is not permitted. Unless a particular SINGLE FAULT CONDITION specifies otherwise, the manufacturer's instructions concerning ventilation, cooling liquid, limits for intermittent use, etc., are followed. Any cooling liquid shall be at the highest RATED temperature. Operating pressures shall be monitored and recorded during all the temperature runs for use in the evaluation of PS.

When measuring temperatures and pressures for REFRIGERATING EQUIPMENT the tests shall be started from a SOAKED TEMPERATURE CONDITION when all pressures have been fully equalized. Tests at the extremes of the input voltage ($\pm 10\%$) shall start under these voltage conditions and achieve a stable state but need not start from a soaked condition. Safety protective devices shall not operate during NORMAL CONDITION tests. At the termination of the test, the monitoring shall continue after the unit is switched off until the pressures from each refrigerant stage have equalized or clearly demonstrate that maximum values have been reached.

During NORMAL CONDITION tests, protective devices other than self-resetting thermal motor-protectors for motor-compressors shall not operate. When steady conditions have been established, thermal motor-protectors for motor-compressors shall not operate.

Addition:

Add the following new subclause at the end of Clause 10:

10.101 Protection against cold surfaces

If minimum surface temperature of easily touched cold surfaces exceeds the value of $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, the cold surface shall be marked with symbol 101 of Table 1 to warn the OPERATOR against frostbite HAZARD.

Conformity is checked by inspection.

11 Protection against HAZARDS from fluids

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

11.7 Fluid pressure and leakage

Addition:

Add the following subclauses at the end of 11.7:

11.7.101 Maximum pressure in a REFRIGERATING SYSTEM

The maximum pressure to which a part of the equipment can be subjected to under NORMAL CONDITION or SINGLE FAULT CONDITION shall not exceed the RATED maximum working pressure for the part. The RATED maximum working pressure of a component is determined by either its RATING (if certified to the component requirements of 14.101) or by design if the parts can pass the tests of 11.7.102.

The maximum allowable pressure (PS) shall be determined by test or by applying the saturated refrigerant pressures at the minimum specified temperatures given in Table 102. In case of doubt, testing shall be performed. If the start-to discharge pressure of a pressure relief valve or the set pressure of a rupture member used in the sealed system is less than the saturated vapor pressure derived from Table 102, it can be used to limit PS for that system. When saturated refrigerant pressures are used to define PS, the manufacturer is exempted from recording the pressures during the normal and abnormal tests. The value of PS when determined by test shall be considered to be the highest of the following:

- a) the maximum pressure developed during the temperature runs as defined by 10.4.1;
- b) the maximum pressure developed during the cooling failure SINGLE FAULT CONDITION test defined by 4.4.2.10.d) or 4.4.2.10.e);
- c) the maximum pressure developed during the test of 4.4.2.101 if applicable;
- d) the maximum pressure developed during the test of 11.7.104.8;

NOTE 1 For each refrigeration stage the pressure system can be separated into two sections, the high and low side of each compressor, and the PS value can be different for each side of the pressure system.

NOTE 2 Equipment meeting the requirements of 11.7 may not be accepted as conforming to national requirements relating to high pressures. There are notes applied to the relevant requirements which detail the modification of these requirements in order to be accepted as evidence of conformity with national regulations in the USA, in Canada, and in some other countries.

Table 102 – Minimum temperature for determination of saturated vapor pressure of refrigerant

Ambient conditions	≤ 43 °C	≤ 55 °C
High pressure side with air cooled condenser	63 °C	67 °C
High pressure side with water cooled condenser or water heat pump	Maximum leaving water temperature + 8 K	
High pressure side with evaporative condenser	43 °C	55 °C
Low pressure side with heat exchanger exposed to the outdoor ambient temperature	43 °C	55 °C
Low pressure side with heat exchanger exposed to the indoor ambient temperature	38 °C	38 °C
<p>NOTE 1 For the high pressure side, the specified temperatures are considered the maximum which will occur during operation. These temperatures are higher than the temperatures that would occur if the compressor had been running and then turned off. For the low pressure side, it is sufficient to base the calculation of pressure on the expected temperature of the compressor after it has been running and then turned off. These temperatures are minimum temperatures and thus determine that the system will not be designed for maximum allowable pressure lower than the saturated refrigerant pressure corresponding to these minimum temperatures.</p> <p>NOTE 2 The use of specified temperatures does not always result in saturated refrigerant pressure within the system, for example a limited charge system or a system working at or above critical temperature, CO₂ in particular.</p> <p>NOTE 3 For zeotropic blends the maximum allowable pressure (PS) is the pressure at the bubble point.</p>		

11.7.102 Leakage and rupture at high pressure

11.7.102.1 General

Refrigerant containing parts of a REFRIGERATING SYSTEM shall not cause a HAZARD through rupture or leakage. The specific requirements for using FLAMMABLE REFRIGERANT or FLAMMABLE REFRIGERANT blends are addressed in 11.7.104.

For components subject to the high-side or low-side pressure of the REFRIGERATING SYSTEM, the structural strength of the fluid containing parts shall comply with 3 × PS as defined by 11.7.101 for the high or low side of the REFRIGERATING SYSTEM.

Conformity is checked by inspection of the RATINGS of the components exposed to this pressure and, if a HAZARD could arise, by the following pressure test. Components that are

certified to the component requirements of 14.101 and are used within their RATINGS (component pressure rating \geq PS) are deemed to comply with this requirement without test.

NOTE 1 For evidence of conformity with national regulations in the USA, in Canada, and in some other countries the structural strength of components are identical but design rating of the component is different based on safety margin required in the national regulations. For example, in the USA the design rating for a component complying with ASME boiler code is 1/5 of the structural strength of the component.

NOTE 2 In conjunction with NOTE 1, the minimum structural strength rating of refrigerant containing components in the USA and Canada is $5 \times$ the maximum pressure measured during normal pressure tests and $3 \times$ maximum pressure measured during abnormal pressure tests. The selection of certified components from North America based on testing conducted in this standard shall take into consideration these certification differences.

11.7.102.2 Pressure test

The pressure of the component or assembly (equipment under test, EUT) is raised, by air or non-HAZARDOUS gas or via a hydrostatic pressure test, gradually to the specified test value and is held at that value for 1 min. If the continuous operating temperature for the EUT is less than or equal to 125 °C for copper or aluminium, or 200 °C for steel, the test temperature of the EUT during this test shall be at least 20 °C. If the continuous operating temperature for the EUT exceeds 125 °C for copper or aluminium, or 200 °C for steel, the test temperature of the EUT during this test shall be at least 150 °C for copper or aluminium and 260 °C for steel. For other materials or higher temperatures, the effects of temperature on the material fatigue characteristics shall be evaluated.

The EUT is considered to have complied with the requirements of this test if it withstands the pressure test without rupture. If the EUT does not comply, then an alternate method to demonstrate compliance is to subject the EUT to the fatigue test detailed below.

11.7.102.3 Fatigue test

If the continuous operating temperature of the EUT exceeds 125 °C for copper or aluminium, or 200 °C for steel, the fatigue test temperature of the parts or assemblies that are at these temperatures, shall be at least 10 K above the continuous operating temperature. Static test pressure shall be increased by the ratio of allowable stress of material at room temperature to that at the highest continuous operating temperature. For other materials, the effects of temperature on the fatigue characteristics shall be evaluated to determine the test conditions.

Three test samples shall be filled with fluid, and shall be connected to a pressure-driving source. The pressure shall be raised and lowered between the upper and lower cyclic values at a rate specified by the manufacturer for a total number of 250 000 cycles. The entire specified pressure excursion shall occur during each cycle.

The following test pressures shall be applied:

For safety purposes, it is suggested that a non-compressible fluid is used.

- *For components at the low pressure side, maximum PS for the low pressure side shall be applied for the first cycle. For components at the high pressure side, maximum PS for the high pressure side shall be applied for the first cycle.*
- *The pressure for the test cycles shall be as follows:
upper pressure value shall not be less than $0,7 \times PS$ and the lower pressure value shall not be greater than $0,2 \times PS$.*
- *For the final test cycle, the test pressure shall be increased to $1,4 \times PS$ (2 times $0,7 \times PS$).*

The component shall not rupture, burst or leak during this test.

A strength pressure test at $2 \times PS$ is to be performed on three samples, other than the samples used for the fatigue test.

The component shall not rupture, burst or leak during this test.

11.7.103 Leakage from low pressure parts of the refrigerant circuit

For REFRIGERATING EQUIPMENT the requirements of 11.7.102 address the low pressure leakage evaluation of the low pressure side of the refrigerant circuit.

11.7.104 Additional requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT that use FLAMMABLE REFRIGERANT

11.7.104.1 General

This standard addresses the requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT which use FLAMMABLE REFRIGERANT when the amount of refrigerant is limited to a maximum of 150 g in each separate refrigerant circuit. For equipment that uses a refrigerant charge of FLAMMABLE REFRIGERANT that exceed this amount additional requirements shall apply.

NOTE 1 ISO 5149 or EN 378-1, EN 378-2, 378-3, and 378-4 are standards that address requirements for REFRIGERATING SYSTEMS that utilize greater than 150 g of FLAMMABLE REFRIGERANT and can be used to identify what the additional requirements may be.

NOTE 2 Equipment containing flammable refrigerants which comply with this standard may not meet the requirements for the US – See informative Annex DD for additional warning markings required for the US.

11.7.104.2 Protected cooling system

REFRIGERATING EQUIPMENT with a protected cooling system are those:

- without any part of the cooling system inside an OPERATOR ACCESS compartment;
- where any part of the cooling system which is located inside an OPERATOR ACCESS compartment is constructed so that the refrigerant is contained within an ENCLOSURE with at least two layers of metallic materials separating the refrigerant from the operator access compartment, each layer having a thickness of at least 0,1 mm. The ENCLOSURE has no joints other than the bonded seams of the evaporator where the bonded seam has a width of at least 6 mm;
- where any part of the cooling system which is located inside an OPERATOR ACCESS compartment has the refrigerant contained in an ENCLOSURE which itself is contained within a separate protective ENCLOSURE. If leakage from the containing ENCLOSURE occurs, the leaked refrigerant is contained within the protective ENCLOSURE and the REFRIGERATING EQUIPMENT will not function as in NORMAL USE. The protective ENCLOSURE shall also withstand the test of 11.7.102. No critical point in the protective ENCLOSURE shall be located within the OPERATOR ACCESS compartment.

Separate compartments with a common air circuit are considered to be a single compartment.

REFRIGERATING EQUIPMENT with a protected cooling system and which use FLAMMABLE REFRIGERANT shall be so constructed as to avoid any fire or explosion HAZARD in the event of leakage of the refrigerant from the cooling system.

Separate components such as thermostats which contain less than 0,5 g of FLAMMABLE REFRIGERANT are not considered to cause a fire or explosion HAZARD in the event of a leakage from the component itself.

For REFRIGERATING EQUIPMENT with a protected cooling system, no additional requirements apply to electrical components located inside operator access compartments.

An equipment with a protected cooling system which, when tested, is found not to comply with the requirements specified for a protected cooling system, may be considered as having an unprotected cooling system if it is tested in accordance with 11.7.104.5 and found to comply with the requirement for an unprotected cooling system.

Compliance is checked by inspection and by the tests of 11.7.104.3 and 11.7.104.4.

11.7.104.3 Leakage test for FLAMMABLE REFRIGERANT

Critical points are only considered to be the interconnecting joints between parts of the refrigerant circuit, including the gasket of a semi-hermetic motor-compressor. Welded telescopic joints of the motor-compressor, the welding of the pipes through the compressor housing and the welding of the hermetic glass-to-metal seals (fusite) are not considered critical points.

To find the most critical point of the cooling system, it may be necessary to perform more than one test.

The method for simulating a leakage is to inject the refrigerant vapour through a capillary tube at the critical point. The capillary tube shall have a bore of 0,7 mm ± 0,05 mm and a length between 2 m and 3 m.

Care should be taken that the installation of the capillary tube does not unduly influence the results of the test and that foreign material does not enter the capillary tube during insulation or assembly for test. The capillary tube may need to be positioned before the equipment is insulated.

During this test the REFRIGERATING EQUIPMENT is tested with doors and lids closed, and is switched off or operated under normal operation at RATED voltage, whichever gives the more unfavourable result.

During a test in which the REFRIGERATING EQUIPMENT is operated, gas injection is started at the same time as the equipment is first switched on.

The quantity of refrigerant of the type indicated by the manufacturer to be injected is equal to 80 % of the nominal charge of the refrigerant ±1,5 g or the maximum that can be injected in 1 h, whichever is the smaller.

The quantity injected is taken from the vapour side of a gas bottle which shall contain enough liquid refrigerant to ensure that, at the end of the test, there is still liquid refrigerant left in the bottle.

If a blend can fractionate, the test is performed using the fraction that has the smallest value of the lower explosive limit.

The gas bottle is kept at a temperature of:

- a) 32 °C ± 2 °C for leakage simulation on low-side pressure circuits;
- b) 70 °C ± 2 °C for leakage simulation on high-side pressure circuits.

The quantity of gas injected should preferably be measured by weighing the bottle.

The concentration of leaked refrigerant is measured at least every 30 s from the beginning of the test and for at least 1 h after injection of the gas has stopped, inside and outside OPERATOR ACCESSIBLE areas, as close as possible to electrical components which, during NORMAL CONDITION or ABNORMAL OPERATION, produce sparks or arcs.

The concentration is not measured close to

- *non-self-resetting protective devices necessary for compliance with single fault testing under 4.4 even if they produce arcs or sparks during operation,*

- *intentionally weak parts that become permanently open-circuited during the single fault testing under 4.4 even if they produce arcs or sparks during operation,*
- *electrical apparatus that has been tested and found to comply with at least the requirements in Annex AA.*

The instrument used for monitoring gas concentrations (such as those which use infra-red sensing techniques) should have a fast response, typically 2 s to 3 s and not unduly influence the result of the test.

If gas chromatography is to be used, the gas sampling in confined areas should occur at a rate not exceeding 2 ml every 30 s.

Other instruments are not precluded from being used provided that they do not unduly influence the results.

The measured value shall not exceed 75 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103, and shall not exceed 50 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103 for a period exceeding 5 min.

Substitution of an inert gas for leak test purposes is permitted if it can be demonstrated that the molecular mass of an inert gas matches that of the FLAMMABLE REFRIGERANT in question.

11.7.104.4 Scratch test for protected cooling systems

All ACCESSIBLE surfaces of protected cooling system, including ACCESSIBLE surfaces in intimate contact with protected cooling system, are scratched using the tool the tip of which is shown in Figure 103.

The TOOL is applied using the following parameters:

- *force at right angles to the surface to be tested 35 N ± 3 N;*
- *force parallel to the surface to be tested not exceeding 250 N.*


The TOOL is drawn across the surface to be tested at a rate of approximately 1 mm/s.

The surface to be tested is scratched at three different positions in a direction at right angles to the axis of the channel and at three different positions on the channel in a direction parallel to it. In the latter case, the length of the scratch shall be approximately 50 mm.

The scratches shall not cross each other.

The appropriate parts of the REFRIGERATING EQUIPMENT shall withstand the test of 11.7.102 with the test pressure reduced by 50 %.

Dimensions in millimetres

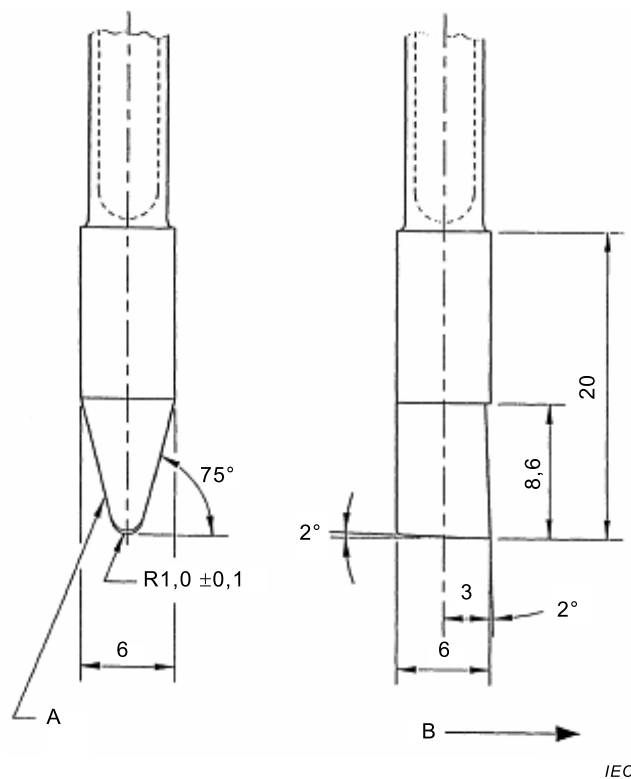**Key**

- A Hard-soldered carbide tip K10
- B Direction of movement

Figure 103 – Scratching TOOL tip details**11.7.104.5 Unprotected cooling systems**

REFRIGERATING EQUIPMENT with an unprotected cooling system are those where at least one part of the cooling system is placed inside an OPERATOR ACCESSIBLE compartment or those which do not comply with 11.7.104.2.

For a REFRIGERATING EQUIPMENT with an unprotected cooling system and which uses FLAMMABLE REFRIGERANT, any electrical component located inside the OPERATOR ACCESSIBLE compartment, which during NORMAL CONDITION or SINGLE FAULT CONDITION produces arcs or sparks, and luminaries, shall be tested and found at least to comply with the requirements of Annex AA for group IIA gases or the refrigerant used.

This requirement does not apply to

- non-self-resetting protective devices necessary for compliance with 4.4, nor to
- intentionally weak parts that become permanently open-circuited during the tests of 4.4, even if they produce arcs or sparks during operation.

Refrigerant leakage into OPERATOR ACCESSIBLE compartments shall not result in an explosive atmosphere outside the OPERATOR ACCESSIBLE compartments in areas where electrical components that produce arcs and sparks during NORMAL OPERATION or ABNORMAL OPERATION, or luminaries, are mounted, when doors or lids remain closed or when opening or closing doors or lids, unless these components have been tested and found at least to comply with Annex AA for group IIA gases or the refrigerant used.

This requirement does not apply to

- non-self-resetting protective devices necessary for compliance with 4.4, nor to
- intentionally weak parts that become permanently open-circuited during the tests of 4.4, even if they produce arcs or sparks during operation.

Separate components such as thermostats which contain less than 0,5 g of flammable gas are not considered to cause a fire or explosion HAZARD in the event of a leakage from the component itself.

Other types of protection for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres covered by the IEC 60079 series are also acceptable.

Changing of a lamp is not considered a potential explosion HAZARD, because the door or lid is open during this operation.

Compliance is checked by inspection, by the appropriate tests of IEC 60079-15 and by the following test.

The tests contained in Annex AA may be carried out using the stoichiometric concentration of the refrigerant used. However, apparatus which has been independently tested and found to comply with Annex AA using the gas specified for group IIA need not be tested.

Irrespective of the requirement given in IEC 60079-15:2010, 5.1, surface temperature limits are specified in 11.7.104.7.

The test is performed in a draught-free location with the REFRIGERATING EQUIPMENT switched off or operated under conditions of normal operation at RATED voltage, whichever gives the more unfavourable result.

During a test in which the REFRIGERATING EQUIPMENT is operated, gas injection is started at the same time as the appliance is first switched on.

The test is performed twice and is repeated a third time if one of the first tests gives more than 40 % of the lower explosive limit.

Through an appropriate orifice, 80 % of the nominal refrigerant charge $\pm 1,5$ g, in the vapour state, is injected into an OPERATOR ACCESSIBLE compartment in a time not exceeding 10 min. The orifice is then closed. The injection shall be as close as possible to the centre of the back wall of the compartment at a distance from the top of the compartment approximately equal to one-third of the height of the compartment. Thirty minutes after the injection is completed, the door or lid is opened at a uniform rate in a time between 2 s and 4 s, to an angle of 90° or to the maximum possible, whichever is less.

For appliances having more than one door or lid, the most unfavourable sequence or combination of opening the lids or doors is used.

For appliances fitted with fan motors the test is performed with the most unfavourable combination of motor operation.

The concentration of leaked refrigerant is measured every 30 s from the beginning of the test, at positions as close as possible to electrical components. However, it is not measured at the positions of

- non-self-resetting protective devices necessary for compliance with 4.4, nor to
- intentionally weak parts that become permanently open-circuited during the tests of 4.4, even if they produce arcs or sparks during operation.

The concentration values are recorded until they tend to go down.

The measured value shall not exceed 75 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103, and shall not exceed 50 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103 for a period exceeding 5 min.

The above test is repeated except that the door or lid is subjected to an open/close sequence at a uniform rate in a time of between 2 s and 4 s, the door or lid being opened to an angle of 90° or to the maximum possible, whichever is less, and closed during the sequence.

11.7.104.6 Stagnation of leaked FLAMMABLE REFRIGERANT

REFRIGERATING EQUIPMENT which use FLAMMABLE REFRIGERANT shall be constructed so that leaked refrigerant will not stagnate and thus cause a fire or explosion HAZARD in areas outside the OPERATOR ACCESSIBLE compartment where components producing arcs or sparks or luminaires are mounted.

This requirement does not apply to areas where

- non-self-resetting protective devices necessary for compliance with 4.4 or
- intentionally weak parts that become permanently open circuited during the test of 4.4

are mounted, even if they produce arcs and sparks during operation.

Separate components such as thermostats that contain less than 0,5 g of flammable gas are not considered to cause a fire or explosion HAZARD in the event of a leakage of the component itself.

Compliance is checked by the following test unless luminaires and components that produce arcs and sparks during normal operation and which are mounted in the areas under consideration, have been tested and found at least to comply with the requirements in Annex AA for group II A gases or the refrigerant used.

Irrespective of the requirements given in IEC 60079-15:2010, 5.1, surface temperature limits are specified in 11.7.104.7.

Other types of protection for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres covered by the IEC 60079 series are also acceptable.

The test is performed in a draught-free location with the appliance switched off or operated under normal operation at RATED voltage, whichever gives the more unfavourable result when an ignition source is present.

During a test in which the equipment is operated, gas injection is started at the same time as the equipment is first switched on.

A quantity equal to 50 % of the refrigerant charge $\pm 1,5$ g is injected into the considered area.

Injection is to be at a constant rate over a period of 1 h and is to be at the point of closest approach of

- pipe-work joints in external parts of the cooling circuit,
- the gaskets of semi-hermetic motor-compressors,

to the electrical component under consideration. Any direct injection shall be avoided.

Welded telescopic joints of the motor-compressor, the welding of the pipes through the compressor housing and the welding of the fusite are not considered to be pipework joints.

The concentration of leaked refrigerant as close as possible to the electrical component is measured continuously from the beginning of the test until it starts to decrease.

The measured value shall not exceed 75 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103, and shall not exceed 50 % of the lower explosive limit of the refrigerant as specified in Table 103 for a period exceeding 5 min.

11.7.104.7 Surface temperature limits

Temperatures on surfaces that may be exposed to leakage of FLAMMABLE REFRIGERANT shall not exceed the ignition temperature of the refrigerant as specified in Table 103, reduced by 100 K.

Compliance is checked by measuring the appropriate surface temperatures during the tests specified in Clause 10 and 4.4.

Temperatures of

- non-self-resetting protective devices that operate during the tests specified in 4.4 or
- intentionally weak parts that become permanently open-circuited during the tests specified in 4.4

are not measured during those tests specified in 4.4 that cause these devices to operate.

Table 103 – Refrigerant flammability parameters

Refrigerant number	Refrigerant name	Refrigerant formula	Refrigerant AUTO IGNITION temperature <small>a c</small> °C	Refrigerant lower explosive limit <small>b c d e</small> % V/V
R50	Methane	CH ₄	645	4,9
R170	Ethane	CH ₃ CH ₃	515	3,1
R290	Propane	CH ₃ CH ₂ CH ₃	470	1,7
R600	n-Butane	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	365	1,5
R600a	Isobutane	CH(CH ₃) ₃	460	1,8
R1150	Ethene	CH ₂ = CH ₂	425	3,1
R1270	Propylene	CH ₂ = CHCH ₃	455	2,3

^a Values for other FLAMMABLE REFRIGERANTS can be obtained from IEC 60079-20 and IEC 60079-20-1.
^b Values for other FLAMMABLE REFRIGERANTS can be obtained from IEC 60079-20 and ISO 5149.
^c IEC 60079-20 is the reference standard. ISO 5149 may be used if the required data is not contained in IEC 60079-20.
^d Concentration of refrigerant in dry air.
^e In some standards, the term “flammability limit” is used for “explosive limit”.

11.7.104.8 Transport temperature test

11.7.104.8.1 General

Pressures developed from SOAKED TEMPERATURE CONDITIONS resulting from the temperatures the REFRIGERATING EQUIPMENT is exposed to during transport shall not cause a HAZARD.

These pressures are used as one input for determining PS (11.7.101) and are derived by test (see below) or from the saturated refrigerant pressures at a transport ambient of 55 °C for normal transport or 70 °C for transport under tropical conditions.

For pressures in parts protected by a pressure relief device, the test pressure shall not exceed 0,9 times the setting of that device during transport.

For a REFRIGERATING SYSTEM that uses FLAMMABLE REFRIGERANTS, the transport ambient shall be 70 °C.

Conformity is checked by inspection of the RATINGS of the components exposed to this pressure and, if a HAZARD could arise, by the tests of 11.7.102. If there is any doubt as to the saturated vapour pressure of the refrigerant in use, then the test pressure shall be derived by one of the following tests 11.7.104.8.2, 11.7.104.8.3 or 11.7.104.8.4, as applicable.

11.7.104.8.2 Transport temperature test method 1

The steps for this method are:

- a) *calculate the total volume of the REFRIGERATING SYSTEM in question;*
- b) *calculate the charge to volume ratio for the design charge;*
- c) *take a charging cylinder of known volume and charge it to give the same volume to mass ratio as the system to be simulated;*
- d) *place the cylinder with a pressure gauge or transducer in a controlled ambient defined by the storage and/or transport ambient temperature and allow the cylinder to soak;*
- e) *record the maximum pressure and use this value as the test pressure for the REFRIGERATING SYSTEM.*

11.7.104.8.3 Transport temperature test method 2

The steps for this method are:

- a) *measure the pressure of the REFRIGERATING SYSTEM under SOAKED TEMPERATURE CONDITION;*
- b) *use an evacuated cylinder and heat it up to SOAKED TEMPERATURE CONDITION;*
- c) *charge the cylinder with the same REFRIGERANT used in the REFRIGERATING SYSTEM under SOAKED TEMPERATURE CONDITION until it has the same pressure as the REFRIGERATING SYSTEM in SOAKED TEMPERATURE CONDITION;*
- d) *place the cylinder with a pressure gauge or transducer in a controlled ambient defined by the storage and/or transport ambient temperature and allow the cylinder to soak;*
- e) *record the maximum pressure and use this value as the test pressure for the REFRIGERATING SYSTEM.*

11.7.104.8.4 Transport temperature test method 3

FLAMMABLE REFRIGERANTS are assumed to be ideal gases. Calculate the pressure at transport and storage conditions by using the ideal gas law, based on the pressure and temperature in SOAKED TEMPERATURE CONDITION.

12 Protection against radiation, including laser sources, and against sonic and ultrasonic pressure

This clause of Part 1 is applicable.

13 Protection against liberated gases and substances, explosion and implosion

This clause of Part 1 is applicable.

14 Components and subassemblies

This clause of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following subclause:

14.101 Components and subassemblies requirements for REFRIGERATING EQUIPMENT

Components and piping that are part of the REFRIGERATING SYSTEM shall comply with the related standards or requirements as indicated in Annex CC or be evaluated to the pressure RATING requirements of this standard (11.7.102).

Conformity is checked by inspection or as specified in 11.7.102 as applicable.

15 Protection by safety interlocks

This clause of Part 1 is applicable.

16 HAZARDS resulting from application

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

16.1 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

Replacement:

Replace the text in 16.1 as follows:

The equipment shall comply with the requirements of this standard during NORMAL USE, including mistakes, lapse, slips or use of an equipment or system in a way not intended by the manufacturer, but which can result from readily predictable human behaviour. Such acts to consider would include well-meant optimization or readily available shortcuts.

No HAZARD shall arise in NORMAL USE or SINGLE FAULT CONDITION, through readily available adjustments, knobs, or other software-based or hardware-based controls set in a way not intended, or not described in the instructions.

Reckless use, unqualified use or use outside the specifications specified by the manufacturer is not considered as part of this standard. Similar, intended acts or intended omission of an act by the OPERATOR of equipment as a result of conduct that is beyond any reasonable means of RISK control by the manufacturer are similarly excluded from the scope of this standard.

Other possible cases of REASONABLY FORESEEABLE MISUSE that are not addressed by specific requirements in this standard shall be addressed by RISK assessment (see Clause 17).

Addition:

Add the following new subclause:

16.101 Slip HAZARD

For walk-in equipment, where the ground or floor may be slippery when wet or icy, the equipment shall be designed and constructed in such a way as to minimise the risk of slipping. Where a slip HAZARD remains, appropriate means which enables the OPERATORS to maintain their stability shall be fitted (for example handholds that are fixed relative to the user) and the equipment shall be permanently marked with symbol 103 of Table 1, warning of slippery surface and against HAZARD of falling. The symbol shall be placed on the door or on the inside wall of the equipment, where it is clearly visible for the OPERATOR during NORMAL USE.

Conformity is checked by inspection.

17 Risk assessment

This clause of Part 1 is applicable.

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable, except as follows:

Annex G (informative)

Leakage and rupture from fluids under pressure

This Annex of Part 1 is applicable except as follows:

Addition:

Add the following new second paragraph:

For fluidic pressure systems incorporating refrigerant the requirements of 11.7 of this standard apply.

Annex L (informative)

Index of defined terms

Addition:

Add the following new defined terms:

Term	Definition
ABNORMAL OPERATION	3.107
FLAMMABLE REFRIGERANT	3.103
HPCO	3.104
PS	3.105
REFRIGERATING SYSTEM	3.102
REFRIGERATING EQUIPMENT	3.101
SOAKED TEMPERATURE CONDITION	3.106

Addition:

Add the following new annexes:

Annex AA (normative)

Non-sparking “n” electrical apparatus

The numbering of the following clauses and subclauses corresponds to the clause and subclause numbers of IEC 60079-15. The clauses and subclauses are applicable except as modified hereafter.

11 Supplementary requirements for non-sparking luminaires

This clause of IEC 60079-15 is applicable, except the following subclauses: 11.2.4.1, 11.2.4.5, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6 and 11.4.

19 Supplementary requirements for sealed devices producing arcs, sparks or hot surfaces

This clause of IEC 60079-15 is applicable, except subclauses 19.1 and 19.6 which are replaced. as follows:

19.1 Non-metallic materials

Replacement:

Seals are tested using 22.5. However if the device is tested in the equipment, then 22.5.1 and 22.5.2 are not applicable. However, after the tests of 4.4, an inspection shall reveal no damage of the encapsulation, such as cracks in the resin or exposure of encapsulated parts that could impair the type of protection.

19.6 Type tests

Replacement:

The type tests described in 22.5 shall be performed where relevant.

20 Supplementary requirements for restricted-breathing enclosures protecting apparatus producing arcs, sparks or hot surfaces

This clause of IEC 60079-15 is applicable.

Annex BB (informative)

HAZARDS associated with REFRIGERATING SYSTEMS and refrigerants

These HAZARDS are associated essentially with the physical and chemical characteristics of refrigerants as well as the pressures and temperatures occurring in refrigeration cycles.

Inadequate precautions may result in:

- component rupture or explosion, with risk of projectiles;
- escape of refrigerant with the risk of environmental damage or toxicity due to a fracture, a leakage caused by bad design, incorrect operation, and inadequate maintenance, repair, charging or disposal;
- burning or combustion of the escaping refrigerant with consequent risk of fire including the risk of toxic products of combustion from non-FLAMMABLE REFRIGERANTS.

Refrigerants, their mixtures and combinations with oils, water or other materials, which are present in the REFRIGERATING SYSTEM, intended or unintended, affect the internal surrounding materials chemically and physically for example due to pressure and temperature. They can, if they have detrimental properties, endanger persons, property and the environment directly or indirectly due to global long term effects (ozone depletion potential, global warming potential) when escaping from the REFRIGERATING SYSTEM.

HAZARDS due to the states of pressure and temperature in REFRIGERATING SYSTEMS are essentially due to the simultaneous presence of the liquid and vapour phases. Furthermore, the state of the refrigerant and the stresses that it exerts on the various components do not depend solely on the processes and functions inside the plant, but also on external factors.

The following HAZARDS are worthy of note:

- a) from the direct effect of extreme temperature, for example:
 - brittleness of materials at low temperatures;
 - freezing of enclosed liquid (water, brine or similar);
 - thermal stresses;
 - changes of volume due to temperature changes;
 - injurious effects to persons caused by low temperatures;
 - touchable hot surfaces.
- b) from excessive pressure due to, for example:
 - increase in the pressure of condensation, caused by inadequate cooling or the partial pressure of non condensable gases or an accumulation of oil or liquid refrigerant;
 - increase in the pressure of saturated vapour due to excessive external heating, for example of a liquid cooler, or when defrosting an air cooler or high ambient temperature when the plant is at a standstill;
 - expansion of liquid refrigerant in a closed space without the presence of vapour, caused by a rise in external temperature;
 - fire.
- c) from the direct effect of the liquid phase, for example:
 - excessive charge or flooding of equipment;
 - presence of liquid in compressors, caused by syphoning, or condensation in the compressor;

- liquid hammer in piping;
 - loss of lubrication due to dilution of oil;
 - condensation-induced shock.
- d) from the escape of refrigerants, for example:
- fire;
 - explosion;
 - toxicity including products of combustion;
 - caustic effects;
 - freezing of skin;
 - asphyxiation;
 - panic;
 - depletion of the ozone layer;
 - global warming.
- e) from the moving parts of machinery, for example:
- injuries;
 - hearing loss from excessive noise;
 - damage due to vibration.

Attention is drawn to HAZARDS common to all compression systems, such as excessive temperature at discharge, liquid slugging (refrigerant getting into the compressor's oil reservoir reducing the lubrication or creating a frothy, incompressible, mixture which could then get sucked into the piston), erroneous operation and reduction in mechanical strength caused by corrosion, erosion, thermal stress, liquid hammer or vibration.

Corrosion, however, should have special consideration as conditions peculiar to REFRIGERATING SYSTEMS arise due to alternate frosting and defrosting or the covering of equipment by insulation.

Annex CC (informative)

Safety requirements for components and piping

CC.1 Overview

The applicable component requirements for sealed system components and the associated piping are defined differently for geographical regions depending on the classification of the pressure vessels in question.

For Europe, the sealed system components may be considered pressure vessels in accordance with the Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC depending on the classification in Tables CC.1 and CC.2. If the components or piping are classified as a Category II or higher pressure vessel according to the PED then the requirements of Table CC.3 shall apply including the use of a Notified Body to the PED.

For North America, the component requirements of Clause CC.2 apply.

Table CC.1 – Parameters of pressure vessels according to EN 14276-1

Fluid	Nature	PS (bar) ^a	V (L)	PS × V (bar×L)	Category/ Article
if	and	and	and	and	Then
GROUP 1	GAS	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5 and ≤ 200	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 25	Art. 3.3 ^c
				> 25 and ≤ 50	I
				> 50 and ≤ 200	II
		> 200 and ≤ 1 000	≤ 1	-	III
		≤ 1 000	> 1	> 200 and ≤ 1 000	III
				> 1 000	IV
	> 1 000	-	-	IV	
	LIQUID ^d	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5 and ≤ 500	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 200	Art. 3.3 ^c
		> 0,5 and ≤ 10		I	
		> 10 and ≤ 500		II	
> 500		< 1	-	II	
> 500		> 1	-	III	

Fluid	Nature	PS (bar) ^a	V (L)	PS × V (bar×L)	Category/ Article
if	and	and	and	and	Then
GROUP 2	GAS	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5 and ≤ 1 000	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 50	Art. 3.3 ^c
				> 50 and ≤ 200	I
				> 200 and ≤ 1 000	II
		> 1 000 and ≤ 3 000	≤ 1	-	III
			> 1	> 1 000 and ≤ 3 000	III
		> 0,5 and ≤ 4		> 1 000	III
	> 4	> 3 000		IV	
	> 3 000	-	-	IV	
	LIQUID ^d	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5 and ≤ 10	-	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 and ≤ 1 000	≤ 10	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 and ≤ 1 000	> 10	≤ 10 000	Art. 3.3 ^c
		> 10 and ≤ 500	-	> 10 000	I
> 1 000		< 10	-	I	
> 500		> 10	> 10 000	II	

a 1 bar = 0,1 MPa

b PED = Pressure Equipment Directive 97/23/EC

c Art. 3.3 = reference to article of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC

d Liquids are considered to be fluids having a vapour pressure not more than 0,5 bar above normal atmospheric pressure (1 013 mbar)

Table CC.2 – Parameters of pipping according to EN 14276-2

Fluid	Nature	PS (bar) ^a	DN	PS × DN (bar) ^a	Category/Article
if	and	and	and	and	then
GROUP 1	GAS	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5	≤ 25	-	Art. 3.3 ^c
			> 25 and ≤ 100	≤ 1 000	I
			> 100 and ≤ 350	> 1 000 and ≤ 3 500	II
			> 350	> 3 500	III
	LIQUID ^d	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5	≤ 25	-	Art. 3.3 ^c
			-	≤ 2 000	Art. 3.3 ^c
		> 0,5 and ≤ 10	-	> 2 000	I
		> 10 and ≤ 500	> 25		II
> 500	-	III			
GROUP 2	GAS	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5	≤ 32	-	Art. 3.3 ^c
			-	≤ 1 000	Art. 3.3 ^c
			> 32 and ≤ 100	> 1 000 and ≤ 3 500	I
			> 100 and ≤ 250	> 3 500 and ≤ 5 000	II
			> 250	> 5 000	III
	LIQUID ^d	≤ 0,5	-	-	Not submitted to PED ^b
		> 0,5 and ≤ 10	-	-	Art. 3.3 ^c
		-	-	≤ 5 000	Art. 3.3 ^c
		-	≤ 200	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 and ≤ 500	> 200	> 5 000	I
		> 500		-	II

a 1 bar = 0,1 MPa

b PED = Pressure Equipment Directive 97/23/EC

c Art. 3.3 = reference to article of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC

d Liquids are considered to be fluids having a vapour pressure not more than 0,5 bar above normal atmospheric pressure (1 013 mbar)

Table CC.3 – Component and piping requirements

COMPONENT	RELATED STANDARD AND REQUIREMENTS
Heat Exchangers: – pipe coil without air (tube in tube)	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Plate heat exchangers	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Headers and coils with air as a secondary fluid	EN 14276-2 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779
Receiver / accumulator / economiser	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Oil separator	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Drier	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Filter	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Muffler	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with 11.7.102 of this standard
Hermetic positive displacement compressor	EN 60335-2-34 or prEN 12693
Semi-hermetic positive displacement compressor	EN 60335-2-34 or prEN 12693
Open positive displacement compressor	prEN 12693
Non positive displacement compressor	EN 14276-1 or EN 13445 if applicable combined with EN 60204-1
Pump General requirements	EN 809 combined with EN 60204-1, and combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779:1999 and the marking requirements from clause 5.1.2 of this standard
Piping	EN 14276-2 or EN 13480
Piping joints Permanent joints Detachable joints	EN 14276-2 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779:1999 and an evaluation of the suitability of the joint for the pipe, piping material, pressure, temperature and fluid.
Flexible piping	EN 1736
Valves	EN12284
safety valve	EN 13136 and EN ISO 4126-1 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779:1999
safety switching devices for limiting the pressure	EN 12263 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779
isolating valves	EN 12284
hand operated valves	EN 12284
valves with seal cap	EN 12284
Bursting disc	EN ISO 4126-2 and EN 13136 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779:1999
Fusible plug	EN 13136 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779 and marked with the melting temperature and working pressure of the fusible material.
Liquid level indicators	EN 12178 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779
Gauges	EN 837-1, EN 837-2 and EN 837-3 combined with a production leak tightness test based on guidance from EN 1779
Brazing and soldering materials	Soldering alloys shall not be used for refrigerant containing purposes where strength is a factor. Brazing alloys shall only be used when their compatibility with refrigerators and lubricants has been proven by test or experience.
Welding materials	EN 14276-2

CC.2 Components and subassemblies requirements for switches and controls used in REFRIGERATING EQUIPMENT for North America

The minimum rating for the number of operations for switches and controls used in a REFRIGERATING SYSTEM shall be as follows:

- quick freeze switches 300
 - manual and semi-automatic defrost switches..... 300
 - door switches 50 000
 - on/off switches 300
 - thermostats which control a motor-compressors 100 000
 - temperature limiters which control defrosting heaters 100 000
 - motor-compressor starting relays 100 000
 - self-resetting thermal motor-protector for motor-compressors 2 000
- NOTE 2 000 or the number of operations during the 15-day locked rotor test, whichever is the greater.
- non self-resetting thermal motor-protector for motor-compressors 50
 - other automatic thermal motor-protectors except for fan motors 2 000
 - other manual reset thermal motor-protectors 30
 - interlock devices 100 000

Table CC.4 – Minimum wall thickness for copper and steel tubing

Outside diameter		Copper				Steel	
		Protected within refrigerator		Unprotected			
inches	(mm)	inches	(mm)	inches	(mm)	inches	(mm)
1/4	(6,35)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
5/16	(7,94)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
3/8	(9,53)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
1/2	(12,70)	0,0245	(0,623)	0,0285	(0,724)	0,025	(0,635)
5/8	(15,88)	0,0315	(0,799)	0,0315	(0,799)	0,032	(0,813)
3/4	(19,05)	0,0315	(0,799)	0,0385	(0,978)	0,032	(0,813)
7/8	(22,23)	0,0410	(1,041)	0,0410	(1,041)	0,046	(1,168)
1	(25,40)	0,0460	(1,168)	0,0460	(1,168)	–	–
1-1/8	(28,58)	0,0460	(1,168)	0,0460	(1,168)	0,046	(1,168)
1-1/4	(31,75)	0,0505	(1,283)	0,0505	(1,283)	0,046	(1,168)
1-3/8	(34,93)	0,0505	(1,283)	0,0505	(1,283)	–	–
1-1/2	(38,10)	0,0555	(1,410)	0,0555	(1,410)	0,062	(1,575)
1-5/8	(41,28)	0,0555	(1,410)	0,0555	(1,410)	–	–
2-1/8	(53,98)	0,0640	(1,626)	0,0640	(1,626)	–	–
2-5/8	(66,68)	0,0740	(1,880)	0,0740	(1,880)	–	–

Nominal wall thickness of tubing will have to be greater than the thickness indicated to maintain the minimum wall thickness.

Annex DD (informative)

Equipment containing FLAMMABLE REFRIGERANTS **Information and marking requirements**

DD.1 Marking, installation and operating instructions (SB6)

DD.1.1 General

For the US additional marking and informational requirements exist for refrigerating equipment which utilise FLAMMABLE REFRIGERANTS. The source document reference is included in brackets at the end of each clause.

DD.1.2 Marking

When a FLAMMABLE REFRIGERANT is used, the markings as outlined in DD.1.3 to DD.1.6, or the equivalent, shall be

- a) in letters no less than 6,4mm (1/4 inch) high and;
- b) permanently marked on the refrigerating equipment in the indicated locations

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.1 revised November 17, 2014)

DD.1.3 OPERATOR markings

“DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices To Defrost Refrigerating Equipment. Do Not Puncture Refrigerant Tubing”.

This marking shall be provided on or near any evaporators that can be contacted by the user.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.2 revised June 28, 2013)

DD.1.4 Service markings

For self-contained REFRIGERATING EQUIPMENT, the following markings shall be located near the machine compartment. For a remote condensing unit, the following markings shall be located by the inter-connecting refrigerant tubing connections and by the nameplate:

- a) “DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing”.
- b) “CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual / Owner’s Guide Before Attempting To Install Or Service This Equipment. All Safety Precautions Must be Followed”.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.3 revised November 30, 2012)

DD.1.5 Disposal

“CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Properly In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used”.

This marking shall be provided on the exterior of the refrigerating equipment.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6 released November 24, 2010)

DD.1.6 Exposed tubing

“CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing. Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used”.

This marking shall be provided near all exposed REFRIGERANT tubing.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6 released November 24, 2010)

DD.1.7 Accessing the refrigerant circuit

Refrigeration tubing or other devices through which the refrigerant is intended to be serviced shall be painted, coloured, or labelled red, Pantone® Matching System (PMS) No. 185. This colour shall be present at all places where service puncturing or otherwise creating an opening in the refrigerant circuit might be expected. In the case of a process tube on a MOTOR-COMPRESSOR, the colour mark shall extend at least 2,5 cm (1 inch) from the motor-compressor.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.6 revised November 17, 2014)

DD.1.8 Symbol for warning of flammable materials

The marking in item DD.1.4 a) shall also contain symbol 102 of Table 1 for warning of flammable materials.

The colour and format of the symbol shall be exactly the same as shown. The perpendicular height of the triangle shall be at least 15 mm (9/16 in).

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.7 revised June 28, 2013)

DD.1.9 Equipment containing a remote condensing unit

For equipment containing a remote condensing unit, the following marking shall be located near the tubing intended for the connection of the field supplied refrigerant tubing:

“CAUTION – This equipment is intended for use with flammable refrigerant. Install in accordance with the flammable refrigerant requirements specified in the ANSI/ASHRAE 15”.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6 released November 24, 2010)

DD.1.10 REFRIGERATING EQUIPMENT intended for laboratory use

REFRIGERATING EQUIPMENT intended for laboratory use that contains an A3 refrigerant shall be marked:

“This unit is intended for use in commercial, industrial, or institutional occupancies as defined in the Safety Standard for Refrigeration Systems, ANSI/ASHRAE 15”.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.1.9 added November 30, 2012)

DD.2 Installation and operating instructions

DD.2.1 Handling and moving

Installation and operating instructions shall be provided with cautionary statements concerning the handling, moving, and use of the refrigerating equipment to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing the RISK of a leak.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6 released November 24, 2010)

DD.2.2 Packaging markings

The shipping carton of REFRIGERATING EQUIPMENT that employs a FLAMMABLE REFRIGERANT shall be marked:

“Caution – RISK Of Fire Or Explosion due to Flammable Refrigerant Used. Follow Handling Instructions Carefully in Compliance with U.S. Government Regulations”.

The warning marking of symbol 102 of Table 1 shall also appear on the shipping carton.

(UL 471 10th Edition, Annex SB6.2.2 revised November 17, 2014)

DD.2.3 Replacement components and servicing

The installation and operating instructions shall indicate that component parts shall be replaced with like components and that servicing shall be done by the manufacturer's authorised personnel, so as to minimize the RISK of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

DD.2.4 Installation instructions for equipment containing a remote CONDENSING UNIT

In addition to the above, the installation instructions for equipment containing a remote condensing unit shall contain the following:

- Information for spaces where pipes containing FLAMMABLE REFRIGERANT are allowed, including statements that (1) the pipe work shall be protected from physical damage and, (2) compliance with the installation requirements of ANSI/ASHRAE 15 shall be observed.
- The minimum necessary room volume per REFRIGERATING SYSTEM charge allowed. See Table DD.1. This may be in the form of a table indicating minimum room volume per refrigerant charge amount, but shall not reference a formula.
- Information for handling, installation, cleaning, servicing and disposal of refrigerant.
- A warning that the equipment shall not be installed in a room with continuously operating open flame or ignition sources.

Table DD.1 – Quantity of Group A2/A3 refrigerant per occupied space

Refrigerant number	Chemical name	Formula	Quantity of refrigerant per occupied space ^a		
			lb./1 000 ft ³	ppm by vol	g/m ³
R-142b	1-Chloro-1,1,- Difluoroethane	CH ₃ CCIF ₂	3,7	14 000	60
R-152a	1,1,- Difluoroethan	CH ₃ CHF ₂	1,2	7 000	20
R-170	Ethane	CH ₃ CH ₃	0,50	6 400	8,0
R-290	Propane	C ₃ H ₈	0,50	4 400	8,0
R-600	Butane	C ₄ H ₁₀	0,51	3 400	8,2
R-600A	2-Methyl propane (Isobutane)	CH(CH ₃) ₃	0,51	3 400	8,2
R-1150	Ethene (Ethylene)	C ₂ H ₄	0,38	5 200	6,0
R-1270	Propene (Propylene)	C ₃ H ₆	0,37	3 400	5,9

NOTE Listed equipment for use in laboratories with more than 100 ft² (9,3m²) of space per person are exempt from this limit provided the equipment is installed in accordance with the listing and with the manufacturer's installation instruction.

^a Values for refrigerants are from ANSI/ASHRAE 15-2013, Table 1.

Bibliography

The Bibliography of Part 1 is applicable, except as follows:

Addition:

Add the following entries to the list:

IEC 60079-20:2010, *Explosive Atmospheres – Part 20: Material characteristics for gas and vapour classification*

IEC 60079-20-1, *Explosive atmospheres – Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data*

ISO 4126-1, *Safety devices for protection against excessive pressure – Part 1: Safety valves*

ISO 4126-2, *Safety devices for protection against excessive pressure – Part 2: Bursting disc safety devices*

ISO 5149 (all parts), *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements*

ISO 5149-1:2014, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 1: Definitions, classification and selection criteria*

ISO 817, *Refrigerants – Designation and safety classification*

ANSI/ASHRAE 15-2013, *Safety Standard for Refrigeration Systems*

ANSI/ASHRAE 34-2013, *Designation and Safety Classification of Refrigerants*

CSA C22.2 No. 120-13, *Refrigeration Equipment*

EN 378-1:2008, *Refrigerant condensing systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Basic requirements, definitions, classification and selection criteria*
EN 378-1:2008/AMD2:2012

EN 378-2:2008, *Refrigerant condensing systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation*
EN 378-2:2008/AMD2:2012

EN 378-3:2008, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Installation site and personal protection*
EN 378-3:2008/AMD1:2012

EN 378-4:2008, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Operation, maintenance, repair and recovery*
EN 378-4:2008/AMD1:2012

EN 809:1998, *Pumps and pump units for liquids – Common safety requirements*

EN 1736:2000, *Refrigerating systems and heat pumps – Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints – Requirements, design and installation*

EN 1779:1999, *Non-destructive testing – Leak testing – Criteria for method and technique selection*

EN 12263:1998, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety switching devices for limiting the pressure – Requirements and tests*

EN 12284:2003, *Refrigerating systems and heat pumps – Valves – Requirements, testing and marking*

EN 12693:2006, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Positive displacement refrigerant compressors*

EN 13136:2001, *Refrigerating systems and heat pumps – Pressure relief devices and their associated piping – Methods for calculation*

EN 13445-1:2002, *Unfired pressure vessels – Part 1: General*

EN 13445-2:2002, *Unfired pressure vessels – Part 2: Materials*

EN 13445-3:2002, *Unfired pressure vessels – Part 3: Design*

EN 13445-4:2002, *Unfired pressure vessels – Part 4: Fabrication*

EN 13445-5:2002, *Unfired pressure vessels – Part 5: Inspection and testing*

EN 13445-6:2002, *Unfired pressure vessels – Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron*

EN 13445-8:2006, *Unfired pressure vessels – Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys*

EN 14276-1:2006, *Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps – Part 1: Vessels – General requirements*

EN 14276-2:2007, *Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps – Part 2: Piping – General requirements*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	48
INTRODUCTION.....	50
1 Domaine d'application et objet	53
2 Références normatives	54
3 Termes et définitions	54
4 Essais	55
5 Marquage et documentation.....	58
6 Protection contre les chocs électriques	61
7 Protection contre les DANGERS mécaniques	61
8 Résistance aux contraintes mécaniques.....	62
9 Protection contre la propagation du feu	62
10 Limites de température de l'appareil et résistance à la chaleur	62
11 Protection contre les DANGERS des fluides	64
12 Protection contre les radiations, y compris les sources laser, et contre la pression acoustique et ultrasonique	75
13 Protection contre les émissions de gaz et substances, les explosions et les implosions	75
14 Composants et sous-ensembles.....	75
15 Protection par systèmes de verrouillage.....	76
16 DANGERS résultant de l'application	76
17 Appréciation du RISQUE	77
Annexes	78
Annexe G (informative) Fuite et rupture des fluides sous pression	78
Annexe L (informative) Index des termes définis.....	78
Annexe AA (normative) Appareils électriques «n» sans étincelle.....	79
Annexe BB (informative) DANGERS associés aux SYSTEMES FRIGORIFIQUES et fluides frigorigènes	80
Annexe CC (informative) Exigences de sécurité pour les composants et les tuyauteries	82
Annexe DD (informative) Exigences relatives aux informations et au marquage des appareils contenant des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES	87
Bibliographie	91
Figure 101 – Schéma d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE comprenant un condenseur.....	51
Figure 102 – Organigramme représentant le processus de sélection	52
Figure 103 – Détails de pointe de L'OUTIL de rayage	70
Tableau 1 – Symboles	59
Tableau 101 – Températures maximales pour les motocompresseurs	63
Tableau 102 – Température minimale pour la détermination de la pression de vapeur saturée du fluide frigorigène.....	65
Tableau 103 – Paramètres d'inflammabilité du fluide frigorigène	74
Tableau CC.1 – Paramètres des récipients sous pression conformément à l'EN 14276-1.....	82

Tableau CC.2 – Paramètres des tuyauteries conformément à l'EN 14276-2.....	84
Tableau CC.3 – Exigences relatives aux composants et aux tuyauteries	85
Tableau CC.4 – Épaisseur minimale de paroi pour les tubes en cuivre et en acier.....	86
Tableau DD.1 – Quantité de fluide frigorigène du Groupe A2/A3 par local occupé	90

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURAGE, DE RÉGULATION ET DE LABORATOIRE –

Partie 2-011: Exigences particulières pour APPAREILS DE REFRIGERATION

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61010-2-011, a été établie par le comité d'études 66 de l'IEC: Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire.

Elle a le statut de publication groupée de sécurité, conformément au Guide 104 de l'IEC.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
66/589/FDIS	66/598/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61010, publiées sous le titre général, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

L'IEC 61010-2-011 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 61010-1. Elle a été établie sur la base de la troisième édition (2010) de l'IEC 61010-1.

La présente Partie 2-011 complète ou modifie les articles correspondants de l'IEC 61010-1 de façon à transformer cette publication en norme IEC: *Exigences particulières pour APPAREILS DE REFRIGERATION*.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans la présente Partie 2, ce paragraphe est applicable pour autant qu'il soit raisonnable. Lorsque la présente partie spécifie «addition», «modification», «remplacement» ou «suppression», il convient d'adapter en conséquence l'exigence, la modalité d'essai ou la note correspondante de la Partie 1.

Dans la présente norme:

1) les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences et définitions: caractères romains;
- NOTES: petits caractères romains;
- *conformité et essais: caractères italiques;*
- termes définis à l'Article 3 et utilisés dans toute cette norme: PETITES CAPITALES ROMAINES.

2) les paragraphes, figures, tableaux et notes complémentaires à ceux de la Partie 1 sont numérotés à partir de 101. Les annexes complémentaires sont désignées à partir de AA.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente norme, ainsi que la Partie 2-010 et la Partie 2-012, couvrent les DANGERS spécifiques associés à l'échauffement et au refroidissement des matières par des appareils, et sont réparties comme suit:

I'IEC 61010-2-010	couvre spécifiquement les DANGERS associés aux appareils comportant des systèmes de chauffage.
I'IEC 61010-2-011	couvre spécifiquement les DANGERS associés aux appareils comportant des SYSTEMES FRIGORIFIQUES.
I'IEC 61010-2-012	couvre spécifiquement les DANGERS associés aux appareils comportant à la fois des systèmes de chauffage et des SYSTEMES FRIGORIFIQUES qui interagissent entre eux de sorte que les systèmes de chauffage et de refroidissement combinés génèrent des DANGERS supplémentaires ou plus graves pour les deux systèmes que s'ils sont traités séparément. Elle couvre également les DANGERS associés au traitement des matières par d'autres facteurs tels que l'exposition aux rayonnements, une humidité excessive, la présence de CO ₂ et un mouvement mécanique.

Guide pour l'application de la ou des parties 2 appropriées

Lorsque l'appareil comprend uniquement un système d'échauffement des matières, et aucun SYSTEME FRIGORIFIQUE, ou lorsque d'autres facteurs d'environnement s'appliquent, la Partie 2-010 s'applique sans que la Partie 2-011 ou la Partie 2-012 ne s'avère nécessaire. De façon analogue, lorsque l'appareil comprend uniquement un SYSTEME FRIGORIFIQUE et aucun système d'échauffement des matières, ou lorsque d'autres facteurs d'environnement s'appliquent, la Partie 2-011 s'applique sans que la Partie 2-010 ou la Partie 2-012 ne s'avère nécessaire. Toutefois, lorsque l'appareil comporte à la fois un système d'échauffement des matières et un SYSTEME FRIGORIFIQUE ou lorsque les matières traitées dans l'application prévue génèrent une chaleur importante dans le SYSTEME FRIGORIFIQUE, il convient de déterminer si l'interaction entre les deux systèmes engendre des DANGERS supplémentaires ou plus graves que si les systèmes étaient évalués séparément (température d'application, voir organigramme pour le processus de sélection). Lorsque l'interaction des fonctions de chauffage et de refroidissement n'engendre aucun DANGER supplémentaire ou plus grave, les deux Parties 2-010 et 2-011 s'appliquent pour leurs fonctions respectives. Inversement, si des DANGERS supplémentaires ou plus graves proviennent de la combinaison des fonctions de chauffage et de refroidissement, ou lorsque l'appareil inclut des facteurs supplémentaires de traitement des matières, la Partie 2-012 s'applique alors, contrairement aux Parties 2-010 et 2-011.

Quels DANGERS sont applicables dans le cas d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE?


Les DANGERS typiques dans le cas d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE (voir Figure 101) comprenant un motocompresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur incluent sans toutefois s'y limiter:

- L'excès de température côté basse pression (température de retour) en direction du motocompresseur est supérieur au niveau admissible. Un motocompresseur comporte un moteur refroidi par fluide frigorigène, et il convient d'établir que les températures maximales du côté basse pression dans les conditions les moins favorables ne dépassent pas les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES d'isolation du moteur.
- L'excès de pression côté basse pression au niveau de l'admission du motocompresseur est supérieur au niveau admissible. L'enveloppe du motocompresseur est exposée à cette pression et il convient d'adapter ses caractéristiques assignées de conception aux

pressions les plus défavorables tout en fournissant la marge de sécurité correcte pour un récipient sous pression.

- L'excès de température côté haute pression en direction du condenseur est supérieur au niveau admissible. Les températures côté haute pression dans les conditions les plus défavorables peuvent présenter un DANGER lié à la température en cas d'exposition de L'OPERATEUR ou de détérioration de l'isolation électrique provoquant un DANGER électrique.
- L'excès de pression côté haute pression en direction du condenseur est supérieur au niveau admissible. Les composants frigorigènes en aval du motocompresseur jusqu'au niveau du détendeur sont exposés à cette pression et il convient d'adapter leurs CARACTERISTIQUES ASSIGNEES de conception aux pressions les plus défavorables tout en fournissant la marge de sécurité correcte pour un récipient sous pression.
- Les températures maximales d'application, d'où la chaleur est extraite, peuvent affecter la température maximale côté basse pression en direction du motocompresseur, ainsi que présenter un DANGER lié à la température en cas d'exposition de L'OPERATEUR ou de détérioration de l'isolation électrique provoquant un DANGER électrique. Que cette température d'application soit issue d'une fonction de chauffage intégrée du dispositif ou de la chaleur dissipée de la matière refroidie, il convient d'évaluer l'effet dans les conditions les plus défavorables.
- Il convient d'établir l'appel de courant de l'appareil lorsque les conditions de fonctionnement les plus défavorables du SYSTEME FRIGORIFIQUE sont prises en compte, y compris les cycles de dégivrage éventuels qui peuvent s'appliquer.


Il convient de déterminer les conditions les plus défavorables pour les appareils qui comprennent à la fois les conditions D'UTILISATION NORMALE les moins favorables, et les résultats d'essai les plus défavorables dans des CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT.

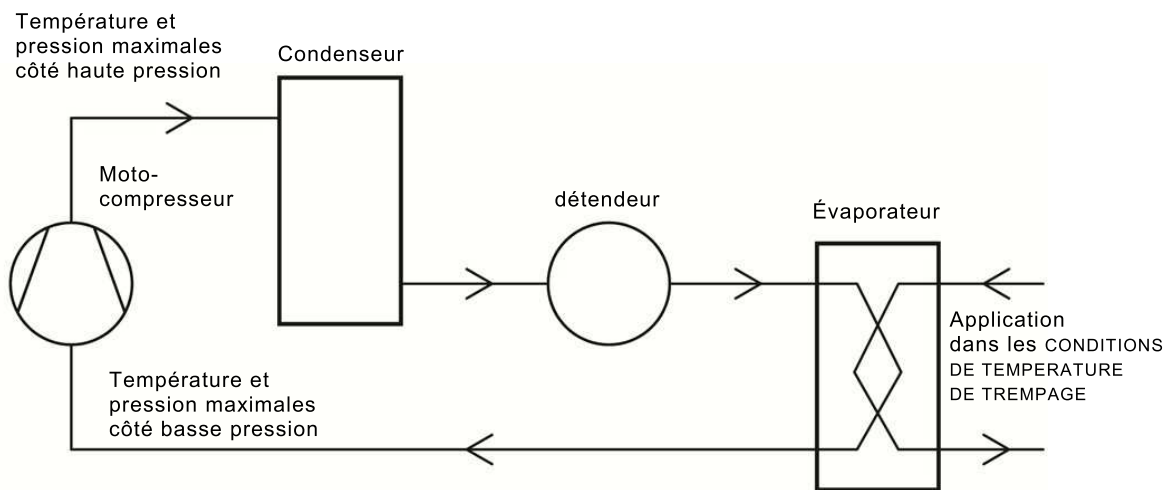

IEC

Figure 101 – Schéma d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE comprenant un condenseur

Le processus de sélection est représenté dans l'organigramme suivant (voir Figure 102).

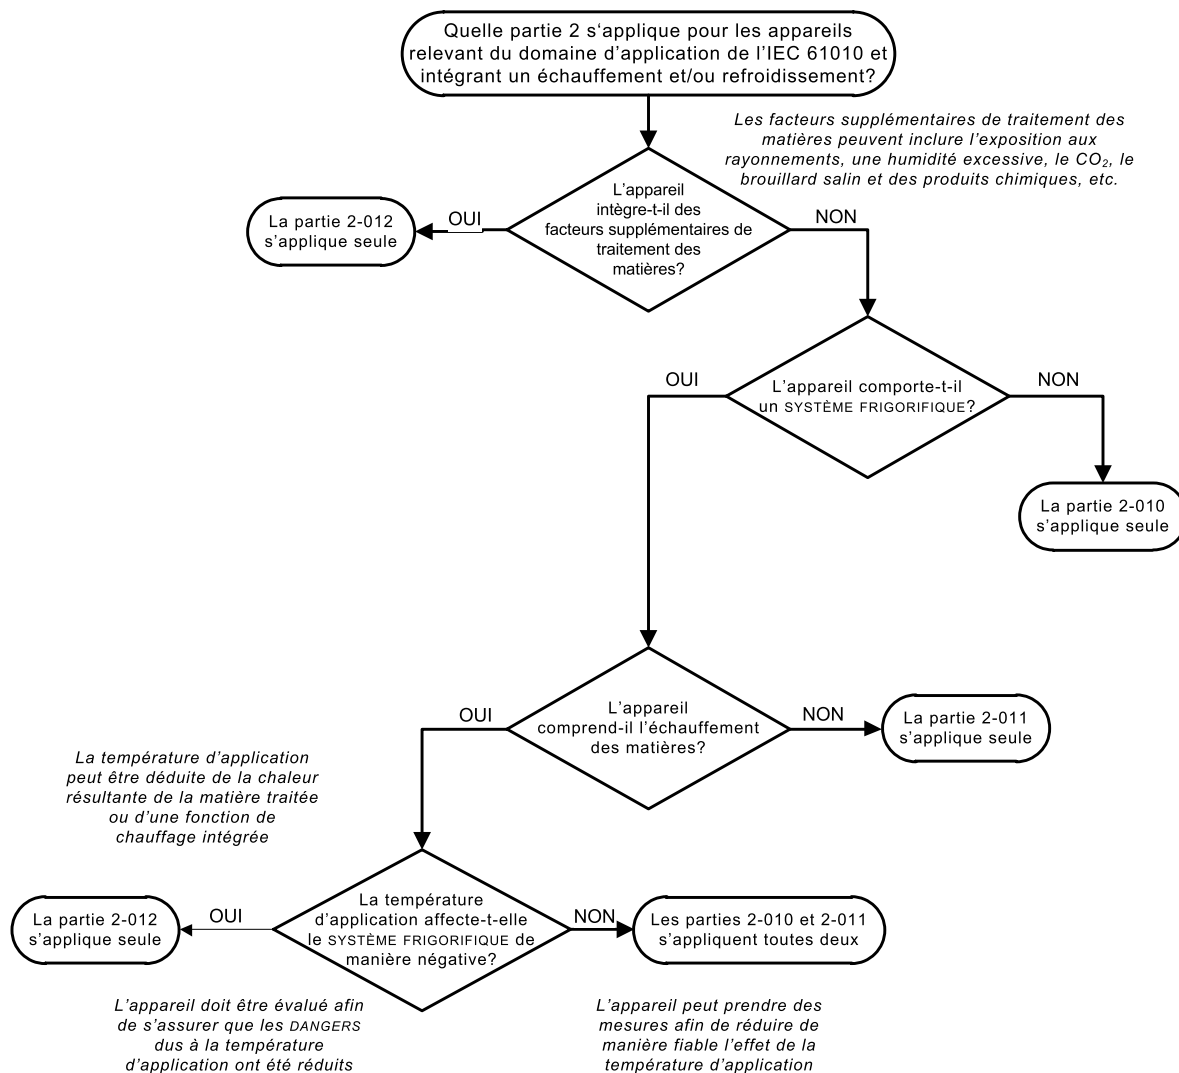

IEC

Figure 102 – Organigramme représentant le processus de sélection

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURAGE, DE RÉGULATION ET DE LABORATOIRE –

Partie 2-011: Exigences particulières pour APPAREILS DE REFRIGERATION

1 Domaine d'application et objet

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

1.1.1 Appareils inclus dans le domaine d'application

Remplacement:

Remplacer le premier alinéa par ce qui suit:

La présente publication groupée de sécurité est principalement destinée à être utilisée en tant que norme en matière de sécurité des produits pour les produits mentionnés dans le domaine d'application. Cependant, elle doit également être utilisée par les comités d'études dans le cadre de l'élaboration de leurs publications pour des produits similaires à ceux mentionnés dans le domaine d'application de la présente norme, conformément aux principes établis dans le Guide IEC 104 et le Guide ISO/IEC 51.

La présente Partie 2 de l'IEC 61010 spécifie les exigences de sécurité particulières pour les types a) à c) suivants d'appareils électriques et leurs accessoires, quel que soit l'endroit dans lequel ils sont destinés à être utilisés, lorsque ces appareils comportent des SYSTEMES FRIGORIFIQUES, que ces derniers fassent partie intégrante des appareils ou qu'ils soient distants des appareils, et que les appareils sont sous la commande directe du SYSTEME FRIGORIFIQUE.

La présente Partie 2 décrit toutes les exigences correspondant à l'utilisation d'une quantité de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE allant jusqu'à 150 g par étage d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE. Lorsqu'une charge de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE dépasse cette quantité, des exigences supplémentaires hors du domaine d'application de la présente norme s'appliquent.

Addition:

Ajouter le texte suivant après le dernier alinéa:

NOTE 101 Les exemples D'APPAREILS DE REFRIGERATION incluent, sans s'y limiter, les appareils de laboratoire tels que les réfrigérateurs de laboratoire, les congélateurs, les vitrines réfrigérées, etc.

Si une ou toutes les parties de l'appareil relèvent du domaine d'application d'une ou plusieurs autres parties 2 de l'IEC 61010, ainsi que du domaine d'application de la présente norme, il convient également que l'appareil satisfasse à l'exigence de ces autres parties 2. En particulier, si l'appareil est prévu pour être utilisé comme centrifugeuse, il convient également qu'il satisfasse aux exigences de l'IEC 61010-2-020. Toutefois, lorsque l'appareil comprend un SYSTEME FRIGORIFIQUE et une fonction de chauffage et qu'une combinaison des deux introduit des DANGERS supplémentaires ou plus graves que s'ils étaient traités séparément, il convient alors d'envisager l'application de l'IEC 61010-2-012 en lieu et place de la présente Partie 2.

Voir d'autres informations dans l'organigramme pour le processus de sélection et les lignes directrices dans l'INTRODUCTION.

1.1.2 Appareils exclus du domaine d'application

Addition:

Ajouter le nouveau point suivant après le point j):

- aa) appareil incorporant un système de réfrigération transcritique (système utilisant du CO₂) ou un système utilisant de l'ammoniaque (NH₃) comme fluide frigorigène.

1.2 Objet

1.2.1 Aspects inclus dans le domaine d'application

Remplacement:

Remplacer the premier alinéa par ce qui suit:

L'objet de la présente Partie 2 est d'assurer que la conception et les méthodes de construction des APPAREILS DE REFRIGERATION fournissent une protection adéquate aux OPERATEURS, aux spectateurs, au personnel de service formé ainsi qu'à la zone périphérique contre les DANGERS spécifiques relatifs aux SYSTEMES FRIGORIFIQUES.

Addition:

Ajouter la note suivante après la note existante:

NOTE 101 Une liste des DANGERS typiquement associés aux SYSTEMES FRIGORIFIQUES et aux fluides frigorigènes est incluse dans l'Annexe BB.

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter à la liste les références suivantes:

IEC 60079-15:2010, *Atmosphères explosives – Partie 15: Protection du matériel par mode de protection «n»*

IEC 60335-2-34:2012, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-34: Exigences particulières pour les motocompresseurs*
IEC 60335-2-34:2012/AMD1:2015

UL 471:2010, *Commercial Refrigerators and Freezers* (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter les termes et définitions suivants:

3.101**APPAREIL DE REFRIGERATION**

appareil d'essai, de mesurage, de régulation et de laboratoire comprenant un SYSTEME FRIGORIFIQUE soit comme partie intégrante de l'appareil soit distant de celui-ci

3.102**SYSTEME FRIGORIFIQUE**

unité assemblée en usine pour effectuer une partie du cycle frigorifique (compression et condensation) comprenant un ou plusieurs compresseurs frigorifiques à moteurs, condenseurs, bouteilles accumulatrices de liquide (le cas échéant), interconnectant la tuyauterie et le matériel d'appoint

3.103**FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE**

fluide frigorigène ayant une classification d'inflammabilité de classe 2 ou 3 conformément à l'ISO 5149-1 et l'ISO 817

Note 1 à l'article: Pour les mélanges de fluides frigorigènes ayant plus d'une classification d'inflammabilité, la classification la plus défavorable est choisie pour les besoins de la présente définition ou l'inflammabilité du mélange est elle-même évaluée conformément à l'ISO 817.

3.104**HPCO****PRESSOSTAT DE SECURITE HAUTE PRESSION**

dispositif actionné par pression conçu pour arrêter le fonctionnement du générateur de pression

Note 1 à l'article: L'abréviation "HPCO" est dérivée du terme anglais développé correspondant "high pressure cut-out".

3.105**PS**

pression maximale admissible telle que déterminée par les résultats compilés d'essais détaillés en 11.7

3.106**CONDITION DE TEMPERATURE DE TREMPAGE**

condition d'environnement de température lorsque toutes les températures de l'appareil en essai (EUT) est égale à la température ambiante d'essai $\pm 2,0$ °C

Note 1 à l'article: L'abréviation "EUT" est dérivée du terme anglais développé correspondant "equipment under test"

3.107**FONCTIONNEMENT ANORMAL**

fonctionnement d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE ayant une plage limitée de températures ambiantes ASSIGNEE en conditions de température ambiante hors des limites imposées par cette plage mais compris dans les limites définies en 1.4.1

4 Essais

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

4.3 Conditions de référence pour les essais**4.3.1 Conditions d'environnement**

Addition:

Ajouter le texte suivant après le point d):

Étant donné que les températures, pressions et appels de courant de fonctionnement pour un SYSTÈME FRIGORIFIQUE sont influencés de manière significative par les températures ambiantes de manière non linéaire, une extrapolation linéaire des données d'essai n'est pas possible. Par conséquent, les essais visant à établir les températures, pressions et appels de courant pour un SYSTÈME FRIGORIFIQUE doivent être menés dans les conditions d'environnement suivantes:

- aa) une température de 40 °C;
- bb) une humidité relative ne dépassant pas les limites définies en 1.4.1 d);

Si l'appareil est ASSIGNE par le fabricant pour fonctionner en conditions d'environnement étendues telles que définies en 1.4.2 ou dans des conditions d'environnement plus limitées conformément à 1.4.1 note 2, ces conditions définissent alors les réglages de 4.3.1 aa) ou 4.3.1 bb).

Lorsque le SYSTÈME FRIGORIFIQUE est refroidi par eau, la température de l'alimentation en eau doit être la température maximale spécifiée par le fabricant (voir 5.4.3) avec la pression d'eau la plus défavorable spécifiée par le fabricant.

Si une condition d'environnement limitée conformément à 1.4.1, note 2, est employée, l'essai de 4.4.2.101 s'applique.

4.3.2 État de l'appareil

4.3.2.1 Généralités

Addition:

Ajouter le texte suivant après le premier alinéa:

Lors de la mesure des températures, pressions et appels de courant des appareils comportant un SYSTÈME FRIGORIFIQUE, les essais doivent commencer dans des CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE lorsque toutes les pressions sont totalement équivalentes. Les essais effectués à des valeurs de tension d'entrée extrêmes ($\pm 10\%$) doivent commencer dans ces conditions de tension et atteindre un état stable, mais il n'est pas nécessaire qu'ils commencent dans des CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE. Les dispositifs de sécurité ne doivent pas fonctionner au cours de cet essai.

4.4.2 Application des conditions de défaut

4.4.2.10 Refroidissement

Remplacement:

Remplacer le texte par ce qui suit:

Pour le refroidissement non associé au refroidissement du SYSTÈME FRIGORIFIQUE:

- a) les événements avec filtres doivent être fermés;
- b) le refroidissement forcé par ventilateurs à moteur doit être arrêté;
- c) le refroidissement par circulation d'eau ou autre liquide de refroidissement doit être arrêté.

Pour le refroidissement associé au refroidissement du SYSTÈME FRIGORIFIQUE:

- d) essai de calage des ventilateurs du condenseur – pour les SYSTÈMES FRIGORIFIQUES refroidis par air

Un par un, chaque ventilateur de condenseur doit être mis à l'arrêt, à moins qu'un premier défaut ne puisse désactiver tous les ventilateurs du condenseur simultanément. Les températures et les pressions doivent être contrôlées selon des intervalles de courte

durée tout au long de l'essai afin de s'assurer de la saisie des valeurs de crête des pressions. Cet essai est mené à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$.

- e) essai de défaillance en eau du condenseur – pour les SYSTEMES FRIGORIFIQUES refroidis par eau

Le SYSTEME FRIGORIFIQUE doit être utilisé en coupant l'alimentation en eau de condensation d'une part, et en limitant l'eau de condensation d'autre part jusqu'à l'obtention de températures maximales stabilisées ou de températures représentatives maximales sous une charge cyclique. Les températures et les pressions doivent être contrôlées selon des intervalles de courte durée tout au long de l'essai afin de s'assurer de la saisie des valeurs de crête des pressions. Cet essai est mené à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$.

- f) Les ailettes du condenseur doivent être bloquées afin de stimuler l'encrassement par la poussière, etc.

Si un HPCO à réarmement manuel est utilisé pour limiter la pression de crête au cours des essais d), e), ou f), il doit alors être réarmé manuellement dans un délai de fonctionnement de 6 secondes pendant 10 cycles.

Si un HPCO à réarmement automatique est utilisé pour limiter la pression de crête au cours des essais d), e), ou f), il doit alors pouvoir fonctionner selon des cycles automatiques jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que des températures et des pressions de crête ont été obtenues.

Lorsqu'il est possible de démontrer qu'un HPCO fonctionne au cours des essais d), e), ou f), le fabricant peut choisir de renoncer à l'essai, mais il règle la pression PS pour les côtés haute et basse pression du motocompresseur sur la pression assignée du HPCO.

Pour les unités comprenant des condenseurs refroidis par air et par eau – seul un à la fois peut être mis en conditions de défaut, à moins que le client ne soit autorisé à faire fonctionner soit le refroidissement par air soit le refroidissement par eau (la conception intègre une option redondante de refroidissement pour le condenseur).

Pour un SYSTEME FRIGORIFIQUE en cascade, lorsqu'un échangeur de chaleur du système du premier étage agit en tant que condenseur du système du deuxième étage, le fabricant peut choisir d'utiliser chaque étage du condenseur individuellement dans le cadre des essais correspondants décrits en d), e) ou f). Dans ce cas, il est considéré que la désactivation du système du premier étage simule le deuxième étage qui fonctionne au cours d'un essai de ventilateur mis à l'arrêt ou de défaillance en eau du condenseur.

Addition:

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

4.4.2.101 Température ambiante extrême en fonctionnement anormal (FONCTIONNEMENT ANORMAL)

Pour les APPAREILS DE REFRIGERATION prévus pour fonctionner dans un environnement limité et soumis à l'essai selon 4.3.1, cet essai supplémentaire de FONCTIONNEMENT ANORMAL doit alors s'appliquer pour simuler la défaillance de l'environnement contrôlé dans l'installation.

Une fois déterminées les conditions d'essai les plus défavorables pour les essais de température et de pression définis en 10.4.1, l'unité est utilisée dans ces conditions jusqu'à stabilisation. L'environnement d'essai est alors porté aux limites de 1.4.1 pour les conditions normales d'environnement (40 °C , HR de 50 %) et l'unité peut se stabiliser et les températures et les pressions maximales sont enregistrées. Le fonctionnement de dispositifs de protection est autorisé au cours de cet essai. Si les conditions de stabilisation ne peuvent pas être atteintes en raison du fonctionnement des dispositifs de protection, les valeurs maximales enregistrées pour cet essai doivent alors être:

- les températures et les pressions maximales au point de fonctionnement de dispositifs non réarmables ou à réarmement manuel. Il n'est pas nécessaire de réarmer le dispositif à réarmement manuel au cours de cet essai; ou
- les températures et les pressions maximales obtenues après des cycles continus des dispositifs de protection à réarmement automatique. Les cycles doivent se poursuivre jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement que les cycles successifs ne développent pas de valeurs maximales plus élevées.

4.4.2.102 Essai de refroidissement non régulé

Les régulateurs de température doivent être neutralisés pour produire un refroidissement non régulé. Ceci s'applique que le régulateur contrôle la température des appareils, du moyen de transfert de chaleur ou de la matière traitée.

4.4.3.1 Généralités

Addition:

Ajouter un nouveau deuxième alinéa:

En raison du temps qu'un SYSTEME FRIGORIFIQUE peut prendre pour atteindre des conditions de stabilisation, la durée des essais de premier défaut peut être supérieure à 4 h, à moins qu'il soit évident que des conditions stables ont été maintenues pendant au moins 1 h.

5 Marquage et documentation

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

5.1.2 Identification

Addition:

Ajouter les nouveaux points suivants après la note qui suit le point b):

- aa) la masse totale du fluide frigorigène pour chaque circuit de fluide frigorigène distinct;
 - bb) pour un fluide frigorigène ayant un seul composant, au moins un des marquages suivants:
 - le nom chimique,
 - la formule chimique,
 - le numéro du fluide frigorigène,
 - cc) pour un mélange de fluides frigorigènes, au moins un des marquages suivants:
 - le nom chimique et la proportion nominale de chacun de ses composants,
 - la formule chimique et la proportion nominale de chacun de ses composants,
 - le numéro du fluide frigorigène et la proportion nominale de chacun de ses composants,
 - le numéro du fluide frigorigène du mélange de fluides frigorigènes;
- NOTE 101 Les numéros des fluides frigorigènes sont indiqués conformément à l'ISO 817 ou à toute autre norme de classification des fluides frigorigènes, par exemple l'ANSI/ASHRAE 34.
- dd) la pression maximale admissible (PS), côtés haute et basse pression pour chaque étage du fluide frigorigène;

NOTE 102 La compilation des résultats des essais qui définissent PS est détaillée en 11.7.101

5.1.3 Alimentation RESEAU

Remplacement:





Remplacer la déclaration de conformité comme suit:

La conformité est vérifiée par examen et par mesurage de la puissance ou du courant d'entrée pour vérifier le marquage indiqué en 5.1.3 c). Le mesurage est effectué avec l'appareil en condition de consommation maximale de puissance, mais afin d'exclure tout courant d'appel initial, il n'est pas effectué tant que le courant ne s'est pas stabilisé (généralement après 1 min). Les valeurs transitoires sont ignorées. Pour les APPAREILS DE REFRIGERATION, il est nécessaire d'évaluer l'impact des températures ambiantes extrêmes et l'interaction de tout mode de dégivrage lors de la détermination de la condition de consommation maximale de puissance.

Addition:

Ajouter les nouveaux symboles suivants dans le Tableau 1:

Tableau 1 – Symboles

Numéro	Symbole	Référence	Description
101		ISO 7010 – W010 (2011-06)	Avertissement; conditions de basse température/gel, DANGER de gelure (MOD)
102		ISO 7010 – W021 (2011-06)	Avertissement; matière inflammable
103		ISO 7010-W011	Avertissement; surface glissante
104		ISO 7010-W024	Avertissement; écrasement des mains

5.2 Marquages des avertissements

Remplacement:

Remplacer le premier alinéa par ce qui suit:

Les marquages d'avertissement spécifiés dans la présente norme doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Remplacer a) par ce qui suit:

- a) la hauteur perpendiculaire du triangle pour tous les symboles d'avertissement doit être de 15 mm au minimum. La hauteur du texte doit être supérieure ou égale à 1,8 mm, en fonction de la taille de l'appareil, de la lisibilité en UTILISATION NORMALE et de l'espace disponible pour le symbole. Les symboles et le texte doivent avoir une couleur contrastée par rapport à la couleur du fond.

Addition:

Ajouter le nouvel alinéa suivant après le dernier alinéa (avant la déclaration de conformité):

Les marquages d'avertissement ou les symboles de DANGERS particuliers qui existent ou se développent uniquement lors de l'installation ou de la maintenance de l'appareil doivent être marqués et visibles uniquement lors de l'exécution de cette maintenance particulière. Par exemple, le marquage du type de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE et de l'agent moussant inflammable doit être visible lors de l'accès aux motocompresseurs, et, dans le cas d'appareils avec une UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE distante, aux raccords de tuyauteries. Le symbole 102 du Tableau 1 doit être placé sur la plaque signalétique de l'unité à proximité de la déclaration du type de fluide frigorigène et des informations de chargement. Il doit être visible après l'installation des APPAREILS DE REFRIGERATION.

5.4 Documentation

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

5.4.1 Généralités

Remplacement:

Remplacer le point d) par:

d) les informations spécifiées de 5.4.2 à 5.4.6, en 5.4.101 et 5.4.102;

5.4.3 Installation des appareils

Remplacement

Remplacer la note par le texte qui suit:

NOTE 1 Il est recommandé d'ajouter une déclaration dans la documentation indiquant que, lors de l'installation, la sécurité de tout système intégrant l'appareil relève de la responsabilité de l'assembleur du système.

NOTE 2 Aux États-Unis, des instructions complémentaires sont exigées concernant les appareils contenant du fluide frigorigène inflammable – voir l'Annexe informative DD.

5.4.4 Fonctionnement de l'appareil

Addition:

Ajouter le nouveau point suivant après 5.4.4 j):

aa) les informations pour permettre un accès sûr au cours de l'utilisation, y compris l'identification des DANGERS de trébuchement et de glissade (voir également 7.3.101 et 16.101).

Addition:

Ajouter les paragraphes suivants:

5.4.101 Instructions supplémentaires pour les appareils comprenant une UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE séparée et prévus pour le raccordement à une alimentation en eau

Pour les appareils comprenant une UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE séparée, les instructions doivent inclure un énoncé comprenant les éléments suivants:

L'installation de L'APPAREIL DE REFRIGERATION et de L'UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE ne doit être effectuée que par le personnel de service du fabricant ou une personne ayant des compétences similaires.

Les informations fournies avec L'APPAREIL DE REFRIGERATION comprenant une UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE séparée doivent comprendre

- des informations sur le type D'UNITE DE CONDENSATION DE FLUIDE FRIGORIGENE séparée à laquelle l'armoire doit être raccordée;
- un schéma électrique présentant les bornes électriques de connexion.

Pour les appareils prévus pour le raccordement à une alimentation en eau à des fins de refroidissement, les instructions doivent comporter des informations sur la température maximale autorisée et les pressions maximales et minimales de l'eau d'entrée cohérentes avec le fonctionnement en toute sécurité des appareils.

5.4.102 Instructions supplémentaires pour les appareils qui utilisent un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE

Pour les appareils qui utilisent un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE, les instructions doivent inclure les informations relatives à la manipulation, à l'entretien et à l'élimination de l'appareil.

Les instructions pour les appareils qui utilisent un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE doivent inclure les avertissements suivants si nécessaire:

- AVERTISSEMENT: Éloigner tout obstacle de l'ensemble des ouvertures de ventilation de l'enveloppe ou de la structure d'intégration.
- AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.

Pour les appareils qui utilisent des agents moussants inflammables, les instructions doivent inclure les informations concernant l'élimination des appareils.

Les instructions concernant les conditionneurs d'air à deux blocs qui utilisent un FLUIDE FRIGORIGENE doivent inclure l'avertissement suivant:

- AVERTISSEMENT: Afin de réduire les DANGERS d'incendie, l'installation de cet appareil doit être effectuée uniquement par une personne dûment qualifiée.

6 Protection contre les chocs électriques

L'article de la Partie 1 est applicable.

7 Protection contre les DANGERS mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

7.3 Parties mobiles

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

7.3.101 Mécanismes de fermeture/verrouillage des portes

Pour les dispositifs de verrouillage comprenant ou ne comprenant pas de mécanismes de verrouillage automatique, lorsqu'un fonctionnement imprudent peut causer des DANGERS d'écrasement pour les mains ou les doigts, le symbole 104 du Tableau 1, avertissement d'un mouvement de parties mécaniques et contre tout DANGER d'écrasement, doit être marqué à l'emplacement ou sur la partie où le DANGER peut survenir.

La conformité est vérifiée par examen.

8 Résistance aux contraintes mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable.

9 Protection contre la propagation du feu

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

9.5.101 Exigences d'avertissement relatives aux liquides inflammables

Lorsqu'un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE, des mélanges de FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES et/ou des agents moussants inflammables sont utilisés, les appareils doivent être marqués avec le symbole 102 du Tableau 1. Des explications supplémentaires concernant le symbole d'avertissement doivent être détaillées dans la documentation destinée à L'OPERATEUR, au personnel de service et à L'AUTORITE RESPONSABLE de l'élimination finale des appareils, y compris les avertissements relatifs aux matières inflammables et contre les DANGERS d'incendie et/ou d'explosion (voir 5.4.102).

Dans d'autres cas, lorsqu'une matière inflammable est présente dans l'appareil, le symbole 102 peut être utilisé comme marquage d'avertissement.

10 Limites de température de l'appareil et résistance à la chaleur

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

10.1 Limites de température des surfaces pour la protection contre les brûlures

Remplacement:

Remplacer le deuxième alinéa par le deuxième alinéa suivant:

Si des surfaces chauffées qui peuvent être facilement touchées sont nécessaires pour des raisons fonctionnelles, qu'elles soient conçues pour fournir de la chaleur ou qu'elles soient chaudes par la proximité des parties chauffées, il est admis que ces surfaces dépassent les valeurs du Tableau 19 en CONDITION NORMALE et 105 °C en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, à condition qu'elles soient identifiables comme telles par l'aspect ou la fonction ou qu'elles soient marquées avec le symbole 13 du Tableau 1 (voir 5.2).

10.2 Température des bobinages

Addition:

Ajouter le texte et le Tableau 101 suivants après le Tableau 20:

La conformité des motocompresseurs est vérifiée par mesurage comme spécifié en 10.4, en CONDITION NORMALE et dans les CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT applicables de 4.4.2.10 et 4.4.2.101 et également dans toutes les autres CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT éventuelles qui peuvent engendrer un DANGER par suite d'une température ou pression excessive. Les limites de température applicables aux motocompresseurs sont définies par le Tableau 101. Les pressions sont enregistrées pour utilisation en 11.7.2.

Pour les motocompresseurs conformes à l'IEC 60335-2-34:2012 et l'IEC 60335-2-34:2012/AMD1:2015 (y compris son Annexe AA), les températures de l'enveloppe et des bobinages des compresseurs ne sont pas mesurées: Pour les motocompresseurs non conformes à ces exigences, les méthodes d'essai des températures détaillées dans l'IEC 60335-2-34 doivent être employées pour mesurer les températures des bobinages.

Tableau 101 – Températures maximales pour les motocompresseurs

1) Partie du motocompresseur	Température (°C)
Bobinages avec	
– isolant synthétique	140 °C
– isolant cellulosique ou analogue	130 °C
Enveloppe	150 °C

10.3 Autres mesures de température

Addition:

Ajouter le nouveau point suivant après 10.3 e):

- aa) La température des composants du SYSTEME FRIGORIFIQUE établit les pressions maximales (voir 11.7.101).

10.4 Réalisation des essais de température

10.4.1 Généralités

Remplacement:

Remplacer le texte par ce qui suit:

La température maximale est déterminée en mesurant la montée en température dans les conditions d'essai de référence définies par 4.3.1 de la présente norme. L'extrapolation linéaire n'est pas admise. À moins qu'une CONDITION DE PREMIER DEFAUT particulière le spécifie autrement, les instructions du fabricant concernant l'aération, le liquide de refroidissement, les limitations pour usage intermittent, etc., sont respectées. Tout liquide de refroidissement doit être à la température maximale ASSIGNEE. Les pressions de fonctionnement doivent être contrôlées et enregistrées pendant tous les essais de température en vue de leur utilisation dans l'évaluation de la pression maximale admissible.

Lors de la mesure des températures et des pressions pour les APPAREILS DE REFRIGERATION, les essais doivent commencer dans des CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE lorsque toutes les pressions sont totalement équivalentes. Les essais effectués à des valeurs de tension d'entrée extrêmes ($\pm 10\%$) doivent commencer dans ces conditions de tension et atteindre un état stable, mais il n'est pas nécessaire qu'ils commencent dans des conditions de trempage. Les dispositifs de sécurité ne doivent pas fonctionner au cours des essais en CONDITIONS NORMALES. À la fin de l'essai, le contrôle doit se poursuivre après la mise hors tension de l'unité, jusqu'à ce que les pressions de chaque étage du fluide frigorigène soient équivalentes ou démontrent clairement que les valeurs maximales ont été atteintes.

Pendant les essais en CONDITIONS NORMALES, les dispositifs de protection autres que les protecteurs thermiques des moteurs des motocompresseurs à réarmement automatique ne doivent pas fonctionner. Lorsque les conditions de stabilisation sont établies, les protecteurs thermiques des moteurs des motocompresseurs ne doivent pas fonctionner.

Addition:

Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin de l'Article 10:

10.101 Protection contre les surfaces froides

Si la température minimale de surface des surfaces froides facilement touchées dépasse -30 °C , la surface froide doit être marquée avec le symbole 101 du Tableau 1 afin d'avertir L'OPERATEUR DU DANGER de gelure.

La conformité est vérifiée par examen.

11 Protection contre les DANGERS des fluides

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

11.7 Fluide sous pression et fuites

Addition:

Ajouter les paragraphes suivants à la fin de 11.7:

11.7.101 Pression maximale dans un SYSTEME FRIGORIFIQUE

La pression maximale à laquelle une partie de l'appareil peut être soumise en CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT ne doit pas dépasser la pression ASSIGNEE maximale de service adaptée à cette partie. La pression ASSIGNEE maximale de service d'un composant est déterminée par ses CARACTERISTIQUES ASSIGNEES (si elles sont certifiées par rapport aux exigences relatives aux composants définies en 14.101) ou par conception, si les parties concernées peuvent satisfaire aux essais de 11.7.102.

La pression maximale admissible (PS) doit être déterminée par essai ou par application des pressions de fluide frigorigène saturé aux températures minimales spécifiées données dans le Tableau 102. En cas de doute, des essais doivent être effectués. Si la pression de début de décharge d'une soupape de surpression ou la pression définie d'un élément de rupture utilisé dans le système scellé est inférieure à la pression de vapeur saturée déduite du Tableau 102, elle peut être utilisée pour limiter la pression maximale admissible adaptée à ce système. Lorsque des pressions de fluide frigorigène saturé servent à définir la pression maximale admissible (PS), le fabricant n'est pas tenu d'enregistrer les pressions pendant les essais pour une utilisation normale et pour une utilisation anormale. La valeur de la pression maximale admissible lorsqu'elle est déterminée par essai doit être considérée comme étant la valeur la plus élevée des valeurs de pression suivantes:

- a) la pression maximale développée pendant l'essai de température tel que défini en 10.4.1;
- b) la pression maximale développée pendant l'essai en CONDITION DE PREMIER DEFAUT pour le refroidissement tel que spécifié en 4.4.2.10.d) ou 4.4.2.10.e);
- c) la pression maximale développée pendant l'essai défini en 4.4.2.101, le cas échéant;
- d) la pression maximale développée pendant l'essai défini en 11.7.104.8;

NOTE 1 Pour chaque étage de réfrigération, le système de pression peut être réparti en deux sections, à savoir le côté haute pression et le côté basse pression de chaque compresseur, et la valeur de la pression maximale admissible peut être différente pour chaque côté du système de pression.

NOTE 2 Les appareils satisfaisant aux exigences de 11.7 peuvent ne pas être acceptés comme conformes aux exigences nationales relatives à des pressions élevées. Des notes s'appliquent aux exigences appropriées qui détaillent la modification de ces exigences afin d'être acceptées comme preuve de conformité aux règlements nationaux des États-Unis, du Canada et de certains autres pays.

Tableau 102 – Température minimale pour la détermination de la pression de vapeur saturée du fluide frigorigène

Conditions ambiantes	≤ 43 °C	≤ 55 °C
Côté haute pression avec condenseur refroidi par air	63 °C	67 °C
Côté haute pression avec condenseur refroidi par eau ou par pompe à chaleur à eau	Température maximale de l'eau d'évacuation + 8 K	
Côté haute pression avec condenseur évaporateur	43 °C	55 °C
Côté basse pression avec exposition de l'échangeur de chaleur à la température ambiante extérieure	43 °C	55 °C
Côté basse pression avec exposition de l'échangeur de chaleur à la température ambiante intérieure	38 °C	38 °C
<p>NOTE 1 Pour le côté haute pression, les températures spécifiées sont considérées comme les températures maximales qui se produisent en fonctionnement. Ces températures sont supérieures aux températures susceptibles d'être observées lorsque le compresseur a fonctionné puis a été arrêté. Pour le côté basse pression, il suffit de baser le calcul de la pression sur la température prévue du compresseur après qu'il a fonctionné puis a été arrêté. Ces températures sont les températures minimales et déterminent ainsi que le système n'est pas conçu pour une pression maximale admissible inférieure à la pression saturée de fluide frigorigène correspondant à ces températures minimales.</p> <p>NOTE 2 L'utilisation de températures spécifiées ne produit pas toujours une pression saturée de fluide frigorigène dans le système, par exemple, un système à charge limitée ou un système qui fonctionne à la température critique ou à une température plus élevée, du CO₂ notamment.</p> <p>NOTE 3 Pour les mélanges zéotropes, la pression maximale admissible (PS) est la pression au point de bulle.</p>		

11.7.102 Fuites et ruptures à haute pression

11.7.102.1 Généralités

Les parties d'un SYSTEME FRIGORIFIQUE contenant le fluide frigorigène ne doivent pas engendrer de DANGER par rupture ou par fuite. Les exigences spécifiques concernant l'utilisation de FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES ou de mélanges de FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES sont traitées en 11.7.104.

Pour les composants soumis à la pression côté haute ou basse pression du SYSTEME FRIGORIFIQUE, la résistance structurale des parties contenant le fluide doit satisfaire à une pression équivalant à 3 fois la pression maximale admissible comme cela est défini en 11.7.101 pour le côté haute ou basse pression du SYSTEME FRIGORIFIQUE.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des composants exposés à cette pression et, si un DANGER peut survenir, par l'essai de pression suivant. Les composants qui sont certifiés selon les exigences applicables définies en 14.101 et qui sont utilisés avec leurs CARACTERISTIQUES ASSIGNEES (pression assignée des composants ≥ pression maximale admissible) sont considérés comme satisfaisant à cette exigence sans effectuer d'essai.

NOTE 1 Pour la preuve de conformité aux règlements nationaux des États-Unis, du Canada et dans certains autres pays, la résistance structurale des composants est identique, mais les caractéristiques assignées de conception des composants sont différentes en fonction de la marge de sécurité exigée par les règlements nationaux. Par exemple, aux États-Unis, les caractéristiques assignées de conception pour un composant se conformant au Boiler Code de l'ASME sont égales à 1/5 de la résistance structurale du composant.

NOTE 2 Conjointement avec la NOTE 1, la résistance structurale assignée minimale des composants contenant le fluide frigorigène aux États-Unis et au Canada est égale à 5 fois la pression maximale mesurée au cours des essais de pression pour une utilisation normale et à 3 fois la pression maximale mesurée au cours des essais de pression pour une utilisation anormale. Le choix des composants certifiés d'Amérique du Nord selon les essais menés dans la présente norme doit prendre en considération ces différences de certification.

11.7.102.2 Essai de pression

La pression du composant ou de l'ensemble (appareil en essai ou EUT) est augmentée par l'action de l'air ou d'un gaz non DANGEREUX, ou au moyen d'un essai de pression hydrostatique, de manière progressive jusqu'à la valeur d'essai spécifiée, et est maintenue à cette valeur pendant 1 min. Si la température de fonctionnement continue de l'EUT est inférieure ou égale à 125 °C pour le cuivre ou l'aluminium, ou à 200 °C pour l'acier, la température d'essai de l'EUT pendant cet essai doit être au moins de 20 °C. Si la température de fonctionnement continue de l'EUT dépasse 125 °C pour le cuivre ou l'aluminium, ou 200 °C pour l'acier, la température d'essai de l'EUT pendant cet essai doit être au moins de 150 °C pour le cuivre ou l'aluminium et de 260 °C pour l'acier. Pour d'autres matériaux ou pour des températures plus élevées, les effets de la température sur les caractéristiques de fatigue des matériaux doivent être évalués.

L'EUT est considéré comme ayant satisfait aux exigences du présent essai s'il résiste à l'essai de pression sans rupture. Si l'EUT ne satisfait pas aux exigences, une autre méthode de démonstration de la conformité consiste alors à soumettre l'EUT à l'essai de fatigue défini ci-dessous.

11.7.102.3 Essai de fatigue

Si la température de fonctionnement continue de l'EUT dépasse 125 °C pour le cuivre ou l'aluminium, ou 200 °C pour l'acier, la température d'essai de fatigue des parties ou ensembles à ces températures doit être au moins 10 K supérieure à la température de fonctionnement continue. La pression statique d'essai doit être augmentée par le rapport de la contrainte admissible du matériau à la température ambiante sur la contrainte admissible à la température de fonctionnement continue la plus élevée. Pour les autres matériaux, les effets de la température sur les caractéristiques de fatigue doivent être évalués afin de déterminer les conditions d'essai.

Trois échantillons d'essai doivent être remplis de fluide et doivent être raccordés à une source d'alimentation de la pression. La pression doit être augmentée et réduite entre les valeurs cycliques supérieures et inférieures à un débit spécifié par le fabricant pour un nombre total de 250 000 cycles. La course de pression spécifiée complète doit se produire pendant chaque cycle.

Les pressions d'essai suivantes doivent être appliquées:

Pour des raisons de sécurité, il est suggéré d'utiliser un fluide non compressible.

- Pour les composants côté basse pression, la pression maximale admissible pour le côté basse pression doit être appliquée pour le premier cycle. Pour les composants côté haute pression, la pression maximale admissible pour le côté haute pression doit être appliquée pour le premier cycle.
- La pression pour les cycles d'essai doit être la suivante:
la valeur de pression supérieure ne doit pas être inférieure à 0,7 fois la pression maximale admissible et la valeur de pression inférieure ne doit pas être supérieure à 0,2 fois la pression maximale admissible.
- Pour le dernier cycle d'essai, la pression d'essai doit être augmentée à 1,4 fois la pression maximale admissible (2 fois une valeur égale à 0,7 fois la pression maximale admissible).

Le composant ne doit pas se rompre, éclater ou fuir pendant cet essai.

Un essai de résistance à la pression à une pression équivalent à 2 fois la pression maximale admissible doit être réalisé sur trois échantillons, autres que les échantillons utilisés pour l'essai de fatigue.

Le composant ne doit pas se rompre, éclater ou fuir pendant cet essai.

11.7.103 Fuite des parties à basse pression du circuit de fluide frigorigène

Pour les APPAREILS DE REFRIGERATION, les exigences de 11.7.102 concernent l'évaluation d'une fuite à basse pression pour le côté basse pression du circuit de fluide frigorigène.

11.7.104 Exigences supplémentaires pour les APPAREILS DE REFRIGERATION qui utilisent un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE

11.7.104.1 Généralités

La présente norme couvre les exigences relatives aux APPAREILS DE REFRIGERATION qui utilisent des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES lorsque la quantité de fluide frigorigène est limitée à un maximum de 150 g dans chaque circuit de fluide frigorigène séparé. Pour les appareils qui utilisent une charge de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE supérieure à cette quantité, des exigences supplémentaires doivent s'appliquer.

NOTE 1 L'ISO 5149 ou l'EN 378-1, l'EN 378-2, l'EN 378-3 et l'EN 378-4 sont des normes qui couvrent les exigences relatives aux SYSTEMES FRIGORIFIQUES qui utilisent une quantité de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE supérieure à 150 g et qui peuvent être utilisés pour identifier les éventuelles exigences supplémentaires.

NOTE 2 Les appareils contenant des fluides frigorigènes inflammables se conformant à la présente norme peuvent ne pas satisfaire aux exigences en vigueur aux États-Unis – Voir l'Annexe DD informative pour les marquages supplémentaires d'avertissement exigés aux États-Unis.

11.7.104.2 Système de refroidissement protégé

Les APPAREILS DE REFRIGERATION ayant un système de refroidissement protégé sont les systèmes qui:

- ne comportent pas de partie du système de refroidissement à l'intérieur d'un compartiment D'ACCES DE L'OPERATEUR;
- comportent toute partie du système de refroidissement à l'intérieur d'un compartiment D'ACCES DE L'OPERATEUR construite de manière à ce que le fluide frigorigène soit contenu dans une ENVELOPPE ayant au moins deux couches de matières métalliques séparant le fluide frigorigène du compartiment d'accès de l'opérateur, chaque couche ayant une épaisseur minimale de 0,1 mm. L'ENVELOPPE n'a pas d'autres jonctions que les joints collés de l'évaporateur d'une largeur minimale de 6 mm;
- comportent toute partie du système de refroidissement à l'intérieur d'un compartiment D'ACCES DE L'OPERATEUR contenant le fluide frigorigène dans une ENVELOPPE elle-même contenue dans une ENVELOPPE de protection séparée. Si une fuite se produit au niveau de L'ENVELOPPE contenant le fluide, le fluide frigorigène qui a fui est contenu dans une ENVELOPPE de protection et L'APPAREIL DE REFRIGERATION ne fonctionne pas en UTILISATION NORMALE. L'ENVELOPPE de protection doit également résister à l'essai de 11.7.102. Aucun point critique de L'ENVELOPPE de protection ne doit être situé dans le compartiment D'ACCES DE L'OPERATEUR.

Les compartiments séparés ayant un circuit d'air commun sont considérés comme un compartiment unique.

Les APPAREILS DE REFRIGERATION ayant un système de refroidissement protégé et qui utilisent du FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE doivent être construits de manière à éviter tout DANGER d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du fluide frigorigène du système de refroidissement.

Les composants séparés tels que les thermostats qui contiennent moins de 0,5 g de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE ne sont pas considérés comme des composants provoquant des DANGERS d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du composant lui-même.

Pour les APPAREILS DE REFRIGERATION ayant un système de refroidissement protégé, aucune exigence supplémentaire ne s'applique aux composants électriques situés à l'intérieur des compartiments d'accès de l'opérateur.

Un appareil ayant un système de refroidissement protégé qui, une fois soumis à l'essai, s'avère ne pas se conformer aux exigences spécifiées pour un système de refroidissement protégé, peut être considéré comme ayant un système de refroidissement non protégé s'il est soumis à des essais conformément à 11.7.104.5 et est considéré comme conforme à l'exigence relative à un système de refroidissement non protégé.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais spécifiés en 11.7.104.3 et 11.7.104.4.

11.7.104.3 Essai de fuite pour les FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES

Les points critiques sont uniquement considérés comme étant des jonctions d'interconnexion entre les parties du circuit de fluide frigorigène, y compris le joint d'un motocompresseur semi-hermétique. Les raccords télescopiques soudés du motocompresseur, le soudage des tuyaux dans l'enveloppe du compresseur et le soudage des joints hermétiques verre-métal (fusite) ne sont pas considérés comme des points critiques.

Afin de déterminer le point le plus critique du système de refroidissement, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs essais.

La méthode de simulation d'une fuite consiste à injecter la vapeur du fluide frigorigène au point critique au moyen d'un tube capillaire. Le tube capillaire doit avoir un alésage de $0,7 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$ et une longueur comprise entre 2 m et 3 m.

Il convient de veiller à ce que l'installation du tube capillaire n'influence pas indûment les résultats de l'essai et qu'une matière étrangère ne pénètre pas dans le tube capillaire au cours de l'isolation ou de l'assemblage pour l'essai. Il peut être nécessaire de positionner le tube capillaire avant que l'appareil ne soit isolé.

Au cours de cet essai, les portes et les couvercles de L'APPAREIL DE REFRIGERATION soumis à l'essai sont fermés, et l'appareil est mis hors tension ou fonctionne normalement à la tension ASSIGNEE, selon le cas qui donne le résultat le plus défavorable.

Au cours d'un essai durant lequel L'APPAREIL DE REFRIGERATION fonctionne, le début de l'injection de gaz et la première mise en marche de l'appareil ont lieu en même temps.

La quantité de fluide frigorigène du type à injecter indiqué par le fabricant est égale à 80 % de la charge nominale du fluide frigorigène $\pm 1,5 \text{ g}$ ou la quantité maximale pouvant être injectée en 1 h, selon la valeur la plus faible.

La quantité injectée est prise du côté vapeur d'une bouteille à gaz qui doit contenir suffisamment de fluide frigorigène liquide afin de garantir qu'à la fin de l'essai il reste encore du fluide frigorigène liquide dans la bouteille.

Si un mélange peut se fractionner, l'essai est effectué à l'aide de la fraction ayant la valeur la plus petite de la limite inférieure d'explosivité.

La bouteille à gaz est conservée à une température de:

- a) $32 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ pour une simulation de fuite sur des circuits du côté basse pression;
- b) $70 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$ pour une simulation de fuite sur des circuits du côté haute pression.

Il convient que la quantité de gaz injecté soit, de préférence, mesurée par pesage de la bouteille.

La concentration de fluide frigorigène ayant fui est mesurée au moins toutes les 30 s à partir du début de l'essai et pendant une durée minimale de 1 h après l'arrêt de l'injection du gaz, à l'intérieur et à l'extérieur des zones ACCESSIBLES A L'OPERATEUR, le plus proche possible des

composants électriques qui, en FONCTIONNEMENT NORMAL ou en FONCTIONNEMENT ANORMAL, produisent des étincelles ou des arcs.

La concentration n'est pas mesurée à proximité

- *de dispositifs de protection non réarmables automatiquement nécessaires pour satisfaire à l'essai de premier défaut défini en 4.4 même s'ils produisent des étincelles ou des arcs au cours du fonctionnement,*
- *de parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours de l'essai de premier défaut défini en 4.4 même si elles produisent des arcs ou des étincelles au cours du fonctionnement,*
- *d'un appareil électrique qui a été soumis à l'essai et qui est considéré comme satisfaisant au moins aux exigences de l'Annexe AA.*

Il convient que l'instrument utilisé pour le contrôle des concentrations de gaz (comme ceux qui utilisent des techniques de détection par infrarouge) ait une réponse rapide, généralement de 2 s à 3 s, et n'influence pas indûment les résultats de l'essai.

Si la chromatographie en phase gazeuse doit être utilisée, il convient de réaliser l'échantillonnage de gaz dans les zones confinées à un taux ne dépassant pas 2 ml en 30 s.

Les autres instruments ne sont pas exclus de toute utilisation à condition qu'ils n'influencent pas indûment les résultats.

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103 pendant une période supérieure à 5 min.

La substitution d'un gaz inerte pour les besoins des essais de fuite est autorisée s'il est possible de démontrer que la masse moléculaire d'un gaz inerte correspond à celle du FLUIDE FRIGORIGÈNE INFLAMMABLE concerné.

11.7.104.4 Essai de résistance aux rayures pour les systèmes de refroidissement protégés

Toutes les surfaces ACCESSIBLES du système de refroidissement protégé, y compris les surfaces ACCESSIBLES en contact direct avec le système de refroidissement protégé, sont rayées à l'aide de la pointe de l'outil qui est représenté à la Figure 103.

L'OUTIL est appliqué selon les paramètres suivants:


- *force appliquée perpendiculairement à la surface à soumettre à l'essai 35 N ± 3 N;*
- *force appliquée parallèlement à la surface à soumettre à l'essai..... inférieure à 250 N.*

L'OUTIL est appliqué à la surface à soumettre à l'essai à une vitesse d'environ 1 mm/s.

La surface à soumettre à l'essai est rayée à trois endroits différents dans une direction perpendiculaire à l'axe du canal et à trois endroits différents sur le canal dans une direction parallèle à celui-ci. Dans ce dernier cas, la longueur de la rayure doit être d'environ 50 mm.

Les rayures ne doivent pas se couper.

Les parties appropriées de L'APPAREIL DE REFRIGERATION doivent résister à l'essai de 11.7.102 avec la pression d'essai réduite de 50 %.

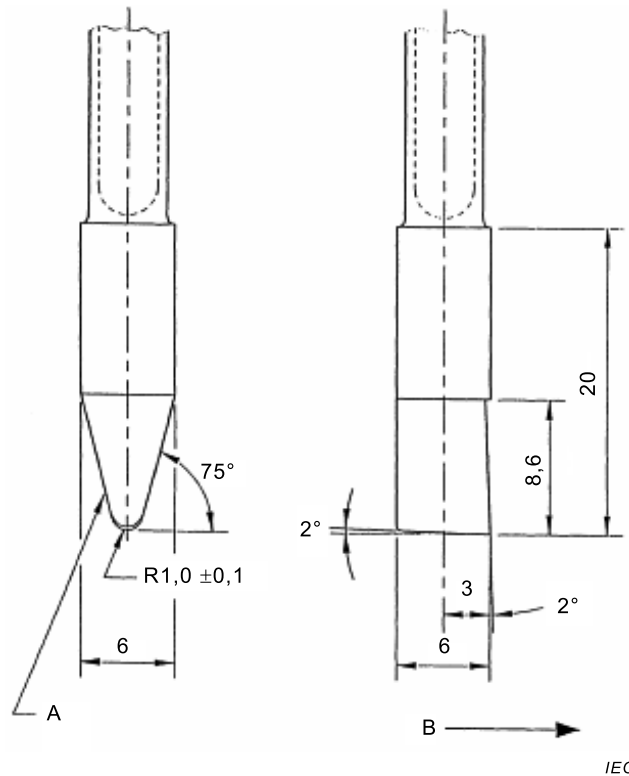

Légende

- A Pointe de carbure brasée K10
- B Direction du mouvement

Figure 103 – Détails de pointe de L'OUTIL de rayage

11.7.104.5 Systèmes de refroidissement non protégés

Les APPAREILS DE REFRIGERATION comportant un système de refroidissement non protégé sont ceux ayant au minimum une partie du système de refroidissement placée à l'intérieur d'un compartiment ACCESSIBLE A L'OPERATEUR ou ceux qui ne se conforment pas à 11.7.104.2.

Pour un APPAREIL DE REFRIGERATION comportant un système de refroidissement non protégé qui utilise du FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE, tout composant électrique situé à l'intérieur d'un compartiment ACCESSIBLE A L'OPERATEUR et qui, en CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, produit des arcs ou des étincelles, ainsi que des luminaires, doivent être soumis à l'essai et considérés comme conformes au minimum aux exigences de l'Annexe AA pour les gaz du groupe IIA ou le fluide frigorigène utilisé.

Cette exigence ne s'applique pas

- aux dispositifs de protection non réarmables automatiquement nécessaires pour satisfaire à 4.4, ni
- aux parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours des essais de 4.4, même si elles produisent des arcs ou des étincelles au cours du fonctionnement.

Les fuites de fluide frigorigène dans les compartiments ACCESSIBLES A L'OPERATEUR ne doivent pas entraîner d'atmosphère explosive à l'extérieur des compartiments ACCESSIBLES A

L'OPERATEUR dans les zones dans lesquelles sont installés les composants électriques qui produisent des arcs et des étincelles au cours du FONCTIONNEMENT NORMAL ou du FONCTIONNEMENT ANORMAL, ou des luminaires, lorsque les portes ou les couvercles restent fermés ou lors de l'ouverture ou de la fermeture des portes ou des couvercles, à moins que ces composants aient été soumis à des essais et soient considérés comme conformes au minimum à l'Annexe AA pour les gaz du groupe IIA ou le fluide frigorigène utilisé.

Cette exigence ne s'applique pas

- aux dispositifs de protection non réarmables automatiquement nécessaires pour satisfaire à 4.4, ni
- aux parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours des essais de 4.4, même si elles produisent des arcs ou des étincelles au cours du fonctionnement.

Les composants séparés tels que les thermostats qui contiennent moins de 0,5 g de gaz inflammable ne sont pas considérés comme des composants provoquant des DANGERS d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du composant lui-même.

D'autres types de protections d'appareils électriques pour les atmosphères explosibles couverts par la série IEC 60079 sont également acceptables.

Le changement d'une lampe n'est pas considéré comme un DANGER potentiel d'explosion, car la porte ou le couvercle est ouvert(e) au cours de cette opération.

La conformité est vérifiée par examen, par les essais appropriés de l'IEC 60079-15 et par l'essai suivant.

Les essais spécifiés dans l'Annexe AA peuvent être réalisés à l'aide de la concentration stœchiométrique du fluide frigorigène utilisé. Cependant, il n'est pas nécessaire de soumettre à l'essai l'appareil qui a été soumis à l'essai de façon indépendante et qui est considéré comme conforme à l'Annexe AA concernant le gaz spécifié pour le groupe IIA.

Indépendamment de l'exigence indiquée dans l'IEC 60079-15:2010, 5.1, les limites de température de surface sont spécifiées en 11.7.104.7.

L'essai est effectué dans un emplacement en air calme avec L'APPAREIL DE REFRIGERATION mis hors tension ou fonctionnant dans des conditions de fonctionnement normal à la tension ASSIGNEE, selon le cas qui donne le résultat le plus défavorable.

Au cours d'un essai durant lequel L'APPAREIL DE REFRIGERATION fonctionne, le début de l'injection de gaz et la première mise en marche de l'appareil ont lieu en même temps.

L'essai est effectué deux fois et est répété une troisième fois si l'un des premiers essais indique des résultats supérieurs de 40 % à la limite inférieure d'explosivité.

Une quantité de 80 % de la charge nominale de fluide frigorigène $\pm 1,5$ g en phase vapeur est injectée, par un orifice approprié, dans un compartiment ACCESSIBLE A L'OPERATEUR pendant une période inférieure à 10 min. L'orifice est ensuite fermé. L'injection doit être réalisée le plus près possible du centre de la paroi arrière du compartiment à une distance du haut du compartiment approximativement égale au tiers de la hauteur du compartiment. Trente minutes après la fin de l'injection, la porte ou le couvercle est ouvert(e) à une vitesse régulière pendant une période comprise entre 2 s et 4 s, à un angle de 90° ou au maximum possible, selon la valeur la plus faible.

Pour les appareils comportant plus d'une porte ou d'un couvercle, la séquence la plus défavorable ou une combinaison de l'ouverture des couvercles ou des portes est utilisée.

Pour les appareils équipés de moteurs de ventilateur, l'essai est effectué avec la combinaison la plus défavorable pour le fonctionnement du moteur.

La concentration de fluide frigorigène ayant fui est mesurée toutes les 30 s à partir du début de l'essai, le plus près possible des composants électriques. Cependant, elle n'est pas mesurée au niveau

- *des dispositifs de protection non réarmables automatiquement nécessaires pour satisfaire à 4.4, ni*
- *des parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours des essais de 4.4, même si elles produisent des arcs ou des étincelles au cours du fonctionnement.*

Les valeurs de concentration sont enregistrées jusqu'à ce qu'elles aient tendance à baisser.

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103 pendant une période supérieure à 5 min.

L'essai ci-dessus est répété sauf que la porte ou le couvercle est soumis à une séquence d'ouverture/fermeture à une vitesse régulière pendant une période comprise entre 2 s et 4 s, la porte ou le couvercle étant ouvert(e) à un angle de 90° ou au maximum possible, selon la valeur la plus faible, et fermé(e) au cours de la séquence.

11.7.104.6 Stagnation du FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE ayant fui

Les APPAREILS DE REFRIGERATION qui utilisent des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES doivent être construits de manière à ce que le fluide frigorigène ne stagne pas et, de ce fait, ne provoque pas de DANGER d'incendie ou d'explosion dans les zones extérieures au compartiment ACCESSIBLE A L'OPERATEUR dans lesquelles sont montés des composants produisant des arcs, des étincelles ou des luminaires.

Cette exigence ne s'applique pas aux zones dans lesquelles sont installés

- des dispositifs de protection non réarmables automatiquement nécessaires pour satisfaire à 4.4, ou
- des parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours des essais de 4.4,

même si ils produisent des arcs et des étincelles au cours du fonctionnement.

Les composants séparés tels que les thermostats qui contiennent moins de 0,5 g de gaz inflammable ne sont pas considérés comme des composants provoquant des DANGERS d'incendie ou d'explosion en cas de fuite du composant lui-même.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant, à moins que les luminaires et les composants produisant des arcs et des étincelles au cours du fonctionnement normal et qui sont montés dans les zones à l'étude aient été soumis à l'essai et soient considérés comme conformes au minimum aux exigences de l'Annexe AA pour les gaz du groupe IIA ou le fluide frigorigène utilisé.

Indépendamment des exigences spécifiées dans l'IEC 60079-15:2010, 5.1, les limites de température de surface sont spécifiées en 11.7.104.7.

D'autres types de protections d'appareils électriques pour les atmosphères explosibles couverts par la série IEC 60079 sont également acceptables.

L'essai est effectué dans un emplacement en air calme avec l'appareil mis hors tension ou fonctionnant en fonctionnement normal à la tension ASSIGNEE, selon le cas qui donne le résultat le plus défavorable lorsqu'une source d'allumage est présente.

Au cours d'un essai durant lequel l'appareil fonctionne, le début de l'injection de gaz et la première mise en marche de l'appareil ont lieu en même temps.

Une quantité égale à 50 % de la charge de fluide frigorigène $\pm 1,5$ g est injectée dans la zone considérée.

L'injection doit être effectuée à une vitesse constante pendant une période de 1 h et à proximité

- des jonctions de tuyauteries dans les parties externes du circuit de refroidissement,*
- des joints des motocompresseurs semi-hermétiques,*

du composant électrique à l'étude. Toute injection directe doit être évitée.

Les raccords télescopiques soudés du motocompresseur, le soudage des tuyaux dans l'enveloppe du compresseur et le soudage de la fusite ne sont pas considérés comme des jonctions de tuyauteries.

La concentration de fluide frigorigène ayant fui le plus près possible du composant électrique est mesurée de façon continue entre le début de l'essai et le moment où elle commence à diminuer.

La valeur mesurée ne doit pas dépasser 75 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103, et ne doit pas dépasser 50 % de la limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103 pendant une période supérieure à 5 min.

11.7.104.7 Limites de température de surface

Les températures sur les surfaces pouvant être exposées aux fuites de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE ne doivent pas être supérieures à la température d'inflammation du fluide frigorigène tel que spécifié au Tableau 103, moins 100 K.

La conformité est vérifiée par mesurage des températures appropriées de surface au cours des essais spécifiés à l'Article 10 et en 4.4.

Les températures

- des dispositifs de protection non réarmables automatiquement qui fonctionnent au cours des essais spécifiés en 4.4 ou*
- des parties intentionnellement faibles qui restent à circuit ouvert de façon permanente au cours des essais spécifiés en 4.4*

ne sont pas mesurées au cours des essais spécifiés en 4.4 qui provoquent le fonctionnement de ces dispositifs.

Tableau 103 – Paramètres d'inflammabilité du fluide frigorigène

Numéro de fluide frigorigène	Nom du fluide frigorigène	Formule du fluide frigorigène	Température D'AUTO-INFLAMMATION du fluide frigorigène ^{a c} °C	Limite inférieure d'explosivité du fluide frigorigène ^{b c d e} % V/V
R50	Méthane	CH ₄	645	4,9
R170	Éthane	CH ₃ CH ₃	515	3,1
R290	Propane	CH ₃ CH ₂ CH ₃	470	1,7
R600	n-Butane	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	365	1,5
R600a	Isobutane	CH(CH ₃) ₃	460	1,8
R1150	Éthène	mtoo = CH ₂	425	3,1
R1270	Propylène	CH ₂ = CHCH ₃	455	2,3

^a Des valeurs peuvent être obtenues pour d'autres FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES dans l'IEC 60079-20 et l'IEC 60079-20-1.

^b Des valeurs peuvent être obtenues pour d'autres FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES dans l'IEC 60079-20 et l'ISO 5149.

^c L'IEC 60079-20 est la norme de référence. L'ISO 5149 peut être utilisée si les données exigées ne sont pas comprises dans l'IEC 60079-20.

^d Concentration de fluide frigorigène à l'air sec.

^e Dans certaines normes, le terme «limite d'inflammabilité» est utilisé pour «limite d'explosivité».

11.7.104.8 Essai de température de transport

11.7.104.8.1 Généralités

Les pressions développées à partir des CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE issues des températures auxquelles L'APPAREIL DE REFRIGERATION est exposé lors du transport ne doivent pas engendrer de DANGER.

Ces pressions sont utilisées comme élément de détermination de la pression maximale admissible (11.7.101) et sont déduites par l'essai (voir ci-dessous) ou des pressions de fluide frigorigène saturé à une température ambiante de transport de 55 °C pour un transport normal ou de 70 °C pour un transport dans des conditions tropicales.

Pour les pressions des parties protégées par un dispositif de limitation de pression, la pression d'essai ne doit pas dépasser 0,9 fois la pression de réglage de ce dispositif pendant le transport.

Pour un SYSTEME FRIGORIFIQUE qui utilise des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES, la température ambiante de transport doit être de 70 °C.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des composants exposés à cette pression et, si un DANGER peut survenir, par les essais de 11.7.102. En cas de doute concernant la PRESSION DE VAPEUR SATUREE du fluide frigorigène utilisé, la pression d'essai doit alors être déduite par l'un des essais suivants: 11.7.104.8.2, 11.7.104.8.3 ou 11.7.104.8.4, selon le cas.

11.7.104.8.2 Méthode d'essai de température de transport 1

Les étapes de cette méthode sont les suivantes:

- a) calculer le volume total du SYSTEME FRIGORIFIQUE concerné;
- b) calculer le rapport de la charge sur le volume pour la charge de conception;

- c) *utiliser une bouteille de charge de volume connu et la charger pour obtenir le même rapport volume-masse que le système à simuler;*
- d) *placer la bouteille avec un manomètre ou un transducteur dans un environnement ambiant contrôlé défini par la température ambiante de stockage et/ou de transport et la laisser tremper;*
- e) *enregistrer la pression maximale et utiliser cette valeur comme la pression d'essai pour le SYSTEME FRIGORIFIQUE.*

11.7.104.8.3 Méthode d'essai de température de transport 2

Les étapes de cette méthode sont les suivantes:

- a) *mesurer la pression du SYSTEME FRIGORIFIQUE dans les CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE;*
- b) *utiliser une bouteille vide et la chauffer jusqu'aux CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE;*
- c) *charger la bouteille avec le même FLUIDE FRIGORIGENE utilisé dans le SYSTEME FRIGORIFIQUE dans les CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE jusqu'à ce que sa pression soit identique à celle du SYSTEME FRIGORIFIQUE dans les CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE;*
- d) *placer la bouteille avec un manomètre ou un transducteur dans un environnement ambiant contrôlé défini par la température ambiante de stockage et/ou de transport et la laisser tremper;*
- e) *enregistrer la pression maximale et utiliser cette valeur comme la pression d'essai pour le SYSTEME FRIGORIFIQUE.*

11.7.104.8.4 Méthode d'essai de température de transport 3

Les FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES sont censés être des gaz parfaits. Calculer la pression aux conditions de transport et de stockage par application de la loi des gaz parfaits, sur la base de la pression et de la température dans les CONDITIONS DE TEMPERATURE DE TREMPAGE.

12 Protection contre les radiations, y compris les sources laser, et contre la pression acoustique et ultrasonique

L'article de la Partie 1 est applicable.

13 Protection contre les émissions de gaz et substances, les explosions et les implosions

L'article de la Partie 1 est applicable.

14 Composants et sous-ensembles

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter le paragraphe suivant:

14.101 Exigences relatives aux composants et sous-ensembles pour les APPAREILS DE REFRIGERATION

Les composants et tuyauteries qui font partie intégrante du SYSTEME FRIGORIFIQUE doivent satisfaire aux normes ou exigences associées comme cela est indiqué dans l'Annexe CC ou être évalués selon les exigences concernant la pression ASSIGNEE de la présente norme (11.7.102).

La conformité est vérifiée par examen ou comme spécifié en 11.7.102, selon le cas.

15 Protection par systèmes de verrouillage

L'article de la Partie 1 est applicable.

16 DANGERS résultant de l'application

L'article de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

16.1 MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PREVISIBLE

Remplacement:

Remplacer le texte de 16.1 comme suit:

L'appareil doit satisfaire aux exigences de la présente norme en UTILISATION NORMALE, y compris les erreurs, les oublis, les écarts, les déviations ou glissades ou l'utilisation non prévue par le fabricant d'un appareil ou d'un système, mais pouvant résulter d'un comportement humain aisément envisageable. De telles actions à prendre en compte comprennent l'optimisation bien intentionnée ou des simplifications rapidement réalisables.

Aucun DANGER ne doit survenir en UTILISATION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFECT, même si les réglages, boutons et autres organes de commandes logicielles ou matérielles facilement accessibles de l'appareil sont positionnés d'une manière non intentionnelle ou non décrite dans les instructions.

Une utilisation imprudente, une utilisation par des personnes non qualifiées ou une utilisation non couverte par les spécifications du fabricant ne relève pas du domaine d'application de la présente norme. De même, des actions prévues ou l'omission prévue d'une action par L'OPERATEUR de l'appareil résultant d'une conduite non couverte par les moyens raisonnables de maîtrise du RISQUE mis en œuvre par le fabricant sont également exclus du domaine d'application de la présente norme.

Les autres cas possibles de MAUVAIS USAGES RAISONNABLEMENT PREVISIBLES non couverts par les exigences spécifiques de la présente norme doivent être abordés par l'appréciation du RISQUE (voir Article 17).

Addition:

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

16.101 DANGER de glissade

Dans le cas des appareils mobiles, dans lesquels le sol ou le plancher quand il est humide ou verglacé, peut être glissant, l'appareil doit être conçu et construit de façon à réduire le plus possible le risque de glissade. Si le DANGER de glissade persiste, des moyens appropriés permettant à L'OPERATEUR de maintenir leur stabilité doivent être prévus (par exemple des poignées fixées par rapport à l'utilisateur). L'appareil doit être marqué de façon permanente

avec le symbole 103 du Tableau 1, pour avertir du fait que la surface est glissante, et du DANGER de chute. Le symbole doit être placé sur la porte ou sur une paroi intérieure de l'appareil, et de manière clairement visible pour l'OPÉRATEUR en UTILISATION NORMALE.

La conformité est vérifiée par examen.

17 Appréciation du RISQUE

L'article de la Partie 1 est applicable.

Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables à l'exception de ce qui suit:

Annexe G (informative)

Fuite et rupture des fluides sous pression

Cette annexe de la partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter le nouveau deuxième alinéa suivant:

Pour les systèmes sous pression fluide comprenant un fluide frigorigène, les exigences de 11.7 de la présente norme s'appliquent.

Annexe L (informative)

Index des termes définis

Addition:

Ajouter les nouveaux termes définis suivants:

Terme	Définition
FONCTIONNEMENT ANORMAL	3.107
FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE	3.103
HPCO (PRESSOSTAT DE SECURITE HAUTE PRESSION)	3.104
PS (PRESSION MAXIMALE ADMISSIBLE)	3.105
SYSTEME FRIGORIFIQUE	3.102
APPAREIL DE REFRIGERATION	3.101
CONDITION DE TEMPERATURE DE TREMPAGE	3.106

Addition:

Ajouter les nouvelles annexes suivantes:

Annexe AA (normative)

Appareils électriques «n» sans étincelle

La numérotation des articles et paragraphes suivants fait référence à la numérotation des articles et paragraphes de l'IEC 60079-15. Les articles et paragraphes sont applicables excepté tels que modifiés ci-dessous.

11 Exigences supplémentaires relatives aux luminaires ne produisant pas d'étincelles

L'article de l'IEC 60079-15 est applicable, à l'exception de 11.2.4.1, 11.2.4.5, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6 et 11.4.

19 Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs clos produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes

L'article de l'IEC 60079-15 est applicable, à l'exception de 19.1 et 19.6, qui sont remplacés comme suit:

19.1 Matériaux non métalliques

Remplacement

Les joints sont soumis à l'essai selon 22.5. Cependant, si le dispositif est soumis à l'essai dans l'appareil, alors les spécifications de 22.5.1 et 22.5.2 ne sont pas applicables. Cependant, après les essais de 4.4, un examen ne doit révéler aucun dommage de l'encapsulage, tel que des fissures dans la résine ou une exposition de parties encapsulées susceptibles de compromettre le type de protection.

19.6 Essais de type

Remplacement:

Les essais de type décrits en 22.5 doivent être effectués le cas échéant.

20 Exigences supplémentaires relatives aux matériels produisant des arcs, des étincelles ou des surfaces chaudes et protégés par des enveloppes à respiration limitée

L'article de l'IEC 60079-15:2010 est applicable.

Annexe BB (informative)

DANGERS associés aux SYSTEMES FRIGORIFIQUES et fluides frigorigènes

Ces DANGERS sont associés essentiellement aux caractéristiques physiques et chimiques des fluides frigorigènes ainsi qu'aux pressions et températures présentes dans les cycles frigorifiques.

Des précautions inadéquates peuvent engendrer:

- une rupture ou une explosion du composant avec un risque de projectiles;
- une fuite du fluide frigorigène avec des risques de dommages ou de toxicité pour l'environnement en raison d'une fracture, d'une fuite provoquée par une mauvaise conception, d'un fonctionnement incorrect, et d'opérations de maintenance, de réparation, de charge ou d'élimination inadéquates;
- l'inflammation ou la combustion du fluide frigorigène libéré entraînant un risque d'incendie, y compris le risque de produits toxiques provenant de la combustion de FLUIDES FRIGORIGENES non INFLAMMABLES.

Les fluides frigorigènes, leurs mélanges et combinaisons avec des huiles, de l'eau ou d'autres matières présentes dans le SYSTEME FRIGORIFIQUE, qu'ils soient prévus ou non prévus, affectent les matières environnantes internes de façon chimique et physique, par exemple, en raison de la pression et de la température. Ils peuvent, s'ils ont des propriétés nuisibles, mettre les personnes, les biens et l'environnement en danger de manière directe ou indirecte, en raison d'effets à long terme à l'échelle mondiale (potentiel d'appauvrissement de l'ozone, potentiel de réchauffement de la planète) lorsqu'ils s'échappent du SYSTEME FRIGORIFIQUE.

Les DANGERS dus aux états de la pression et de la température des SYSTEMES FRIGORIFIQUES sont essentiellement dus à la présence simultanée des phases liquides et vapeur. De plus, l'état du fluide frigorigène et les contraintes qu'il exerce sur les différents composants ne dépendent pas uniquement des processus et des fonctions au sein de l'installation, mais également de facteurs externes.

Les DANGERS suivants méritent d'être pris en compte:

- a) résultant d'un effet direct d'une température extrême, par exemple:
 - la fragilité des matières à des températures basses;
 - le gel de liquide enfermé (eau, saumure ou liquide similaire);
 - les contraintes thermiques;
 - les changements de volume en raison de variations de température;
 - les effets nocifs sur les personnes en raison de températures basses;
 - les surfaces chaudes pouvant être touchées.
- b) résultant d'une pression excessive en raison, par exemple:
 - d'une augmentation de la pression de condensation, provoquée par un refroidissement inadéquat ou la pression partielle de gaz non condensables ou une accumulation d'huile ou de fluide frigorigène liquide;
 - d'une augmentation de la pression de la vapeur saturée en raison d'un échauffement externe excessif, par exemple, un refroidisseur de liquide, ou lors du dégivrage d'un refroidisseur d'air ou d'une température ambiante élevée lorsque l'installation est à l'arrêt;
 - d'une dilatation du fluide frigorigène liquide dans un espace fermé en l'absence de vapeur, provoquée par une augmentation de la température externe;

- d'un incendie.
- c) résultant d'un effet direct d'une phase liquide, par exemple:
- une charge excessive ou l'inondation des appareils;
 - la présence de liquide dans les compresseurs provoquée par effet d'aspiration, ou de condensation dans le compresseur;
 - un coup de bélier dans la tuyauterie;
 - une perte de lubrification en raison de la dilution de l'huile;
 - un choc induit par condensation.
- d) résultant d'une fuite de fluides frigorigènes, par exemple:
- un incendie;
 - une explosion;
 - la toxicité, y compris les produits de combustion;
 - les effets corrosifs;
 - le gel de la peau;
 - l'asphyxie;
 - la panique;
 - l'appauvrissement de la couche d'ozone;
 - le réchauffement climatique.
- e) résultant de parties mobiles des machines, par exemple:
- des blessures;
 - des pertes d'audition résultant d'un bruit excessif;
 - des dommages dus aux vibrations.

L'attention est attirée sur les DANGERS communs à tous les systèmes de compression, tels qu'une température excessive lors de la décharge, un coup de liquide (le fluide frigorigène pénètre dans le réservoir d'huile du compresseur, ce qui réduit la lubrification ou crée un mélange mousseux et incompressible pouvant être aspiré dans le piston), un mauvais fonctionnement et la réduction de la résistance mécanique causée par la corrosion, l'érosion, la contrainte thermique, le coup de bélier ou les vibrations.

Il convient toutefois de porter une attention particulière à la corrosion étant donné que des conditions spécifiques AUX SYSTEMES FRIGORIFIQUES surviennent en raison de l'alternance de gel et de dégivrage ou du revêtement d'isolation des appareils.

Annexe CC (informative)

Exigences de sécurité pour les composants et les tuyauteries

CC.1 Vue d'ensemble

Les exigences applicables concernant les composants de systèmes scellés et les tuyauteries associées sont définies différemment selon les régions géographiques en fonction de la classification des récipients sous pression concernés.

Pour l'Europe, les composants de systèmes scellés peuvent être considérés comme des récipients sous pression conformément à la Directive Équipements sous pression (DEP) 97/23/CE selon la classification des Tableaux CC.1 et CC.2. Si les composants ou les tuyauteries sont classés comme un récipient sous pression de catégorie II ou plus selon la DEP, les exigences du Tableau CC.3 doivent alors s'appliquer, y compris le recours à un organisme notifié selon la DEP.

Pour l'Amérique du Nord, les exigences relatives aux composants définies à l'Article CC.2 s'appliquent.

Tableau CC.1 – Paramètres des récipients sous pression conformément à l'EN 14276-1

Fluide	Nature	PS (bar) ^a	V (L)	PS × V (bar×L)	Catégorie/ Article
si	et	et	et	et	alors
GROUPE 1	GAZ	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5 et ≤ 200	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 25	Art. 3.3 ^c
				> 25 et ≤ 50	I
		> 50 et ≤ 200	II		
		> 200 et ≤ 1 000	≤ 1	-	III
		≤ 1 000	>1	> 200 et ≤ 1 000	III
	> 1 000	-	> 1 000	IV	
	LIQUIDE ^d	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5 et ≤ 500	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 200	Art. 3.3 ^c
				> 200	I
		> 0,5 et ≤ 10	> 1	> 200	II
		> 10 et ≤ 500	> 1	> 200	II
> 500		<1	-	II	
> 500	>1	-	III		

Fluide	Nature	PS (bar) ^a	V (L)	PS × V (bar×L)	Catégorie/ Article
si	et	et	et	et	alors
GROUPE 2	GAZ	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5 et ≤ 1 000	≤ 1	-	Art. 3.3 ^c
			> 1	≤ 50	Art. 3.3 ^c
				> 50 et ≤ 200	I
				> 200 et ≤ 1 000	II
		> 1 000 et ≤ 3 000	≤ 1	-	III
			> 1	> 1 000 et ≤ 3 000	III
		> 0,5 et ≤ 4		> 1 000	III
		> 4		> 3 000	IV
	> 3 000	-	-	IV	
	LIQUIDE ^d	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5 et ≤ 10	-	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 et ≤ 1 000	≤ 10	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 et ≤ 1 000	> 10	≤ 10 000	Art. 3.3 ^c
		> 10 et ≤ 500	-	> 10 000	I
> 1 000		< 10	-	I	
> 500		> 10	> 10 000	II	

a 1 bar = 0,1 MPa

b DEP = Directive Équipements sous pression 97/23/CE

c Art. 3.3 = référence à l'Article 3.3 de la directive Équipements sous pression 97/23/CE

d Les liquides sont considérés comme des fluides dont la pression de vapeur n'est pas supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar)

Tableau CC.2 – Paramètres des tuyauteries conformément à l'EN 14276-2

Fluide	Nature	PS (bar) ^a	DN	PS × DN (bar) ^a	Catégorie/Article
si	et	et	et	et	alors
GROUPE 1	GAZ	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5	≤ 25	-	Art. 3.3 ^c
			> 25 et ≤ 100	≤ 1 000	I
			> 100 et ≤ 350	> 1 000 et ≤ 3 500	II
			> 350	> 3 500	III
	LIQUIDE ^d	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5	≤ 25	-	Art. 3.3 ^c
			-	≤ 2 000	Art. 3.3 ^c
		> 0,5 et ≤ 10	-	> 2 000	I
		> 10 et ≤ 500	> 25		II
> 500	-	III			
GROUPE 2	GAZ	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5	≤ 32	-	Art. 3.3 ^c
			-	≤ 1 000	Art. 3.3 ^c
			> 32 et ≤ 100	> 1 000 et ≤ 3 500	I
			> 100 et ≤ 250	> 3 500 et ≤ 5 000	II
	> 250		> 5 000	III	
	LIQUIDE ^d	≤ 0,5	-	-	Non soumis à la DEP ^b
		> 0,5 et ≤ 10	-	-	Art. 3.3 ^c
		-	-	≤ 5 000	Art. 3.3 ^c
		-	≤ 200	-	Art. 3.3 ^c
		> 10 et ≤ 500	> 200	> 5 000	I
		> 500		-	II

a 1 bar = 0,1 MPa

b DEP = Directive Équipements sous pression 97/23/CE

c Art. 3.3 = référence à l'Article 3.3 de la directive Équipements sous pression 97/23/CE

d Les liquides sont considérés comme des fluides dont la pression de vapeur n'est pas supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar)

Tableau CC.3 – Exigences relatives aux composants et aux tuyauteries

COMPOSANT	NORMES ET EXIGENCES ASSOCIÉES
Échangeurs de chaleur: – serpentin sans air (tube dans un tube)	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Échangeurs thermiques à plaques	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Collecteurs et serpentins avec air comme fluide secondaire	EN 14276-2 combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779
Réservoir/accumulateur/économiseur	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Séparateur d'huile	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Déshydrateur	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Filtre	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Silencieux	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à 11.7.102 de la présente norme
Compresseur volumétrique hermétique	EN 60335-2-34 ou prEN 12693
Compresseur volumétrique hermétique accessible	EN 60335-2-34 ou prEN 12693
Compresseur volumétrique ouvert	prEN 12693
Compresseur non volumétrique	EN 14276-1 ou EN 13445 si applicable combinée à l'EN 60204-1
Pompe Exigences générales	EN 809 combinée à l'EN 60204-1 et combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779:1999 ainsi qu'aux exigences de marquage fournies en 5.1.2 de la présente norme
Tuyauteries	EN 14276-2 ou EN 13480
Joints de tuyauterie Joints non démontables Joints démontables	EN 14276-2 combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779:1999 ainsi qu'une évaluation de l'adéquation des joints pour les tuyauteries, les matériaux des tuyauteries, la pression, la température et les fluides.
Tuyauteries flexibles	EN 1736
Robinet	EN 12284
Soupape de sûreté	EN 13136 et EN ISO 4126-1 combinées à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779:1999
Dispositifs interrupteurs de sécurité de limitation de la pression	EN 12263 combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779:1999
Robinets d'isolement	EN 12284
Robinets à commande manuelle	EN 12284
Robinets à capuchon	EN 12284
Disque de rupture	EN ISO 4126-2 et EN 13136 combinées à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779
Bouchon fusible	EN 13136 combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779:1999 et marquage de la température de fusion et de la pression de service de la matière fusible.
Indicateurs de niveau de liquide	EN 12178 combinée à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779
Indicateurs	EN 837-1, EN 837-2 et EN 837-3 combinées à un essai d'étanchéité de production d'après les lignes directrices de l'EN 1779
Matériaux de brasage tendre et de brasage fort	Les alliages de brasage fort ne doivent pas être utilisés pour des usages destinés à contenir du fluide frigorigène lorsque la résistance est prise en considération. Les alliages de brasage tendre doivent uniquement être utilisés lorsque leur compatibilité avec les réfrigérants et les lubrifiants a été prouvée par des essais ou par expérience.
Matériaux de soudage	EN 14276-2

CC.2 Exigences relatives aux composants et aux sous-ensembles pour les interrupteurs et commandes utilisés dans les APPAREILS DE REFRIGERATION (Amérique du Nord)

Le nombre minimal assigné de manœuvres pour les interrupteurs et commandes utilisés dans un SYSTEME FRIGORIFIQUE doit être le suivant:

- interrupteurs de congélation rapide 300
 - interrupteurs de dégivrage manuel et semi-automatique 300
 - interrupteurs de porte 50 000
 - interrupteurs marche/arrêt 300
 - thermostats de commande du motocompresseur 100 000
 - limiteurs de température régulant les éléments chauffants de dégivrage 100 000
 - relais de démarrage du motocompresseur 100 000
 - protecteur thermique de moteur à réarmement automatique pour motocompresseurs. 2 000
- NOTE 2 000, ou le nombre de manœuvres pendant l'essai à rotor bloqué de 15 jours, selon la plus grande des deux valeurs.
- protecteur thermique de moteur sans réarmement automatique pour motocompresseurs. 50
 - autres protecteurs thermiques de moteur automatiques, à l'exception de ceux des moteurs de ventilateurs 2 000
 - autres protecteurs thermiques de moteur à réarmement manuel 30
 - dispositifs de verrouillage 100 000

Tableau CC.4 – Épaisseur minimale de paroi pour les tubes en cuivre et en acier

Diamètre extérieur		Cuivre				Acier	
		Protégé dans le réfrigérant		Non protégé			
pouces	(mm)	pouces	(mm)	pouces	(mm)	pouces	(mm)
1/4	(6,35)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
5/16	(7,94)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
3/8	(9,53)	0,0245	(0,623)	0,0265	(0,673)	0,025	(0,635)
1/2	(12,70)	0,0245	(0,623)	0,0285	(0,724)	0,025	(0,635)
5/8	(15,88)	0,0315	(0,799)	0,0315	(0,799)	0,032	(0,813)
3/4	(19,05)	0,0315	(0,799)	0,0385	(0,978)	0,032	(0,813)
7/8	(22,23)	0,0410	(1,041)	0,0410	(1,041)	0,046	(1,168)
1	(25,40)	0,0460	(1,168)	0,0460	(1,168)	-	-
1-1/8	(28,58)	0,0460	(1,168)	0,0460	(1,168)	0,046	(1,168)
1-1/4	(31,75)	0,0505	(1,283)	0,0505	(1,283)	0,046	(1,168)
1-3/8	(34,93)	0,0505	(1,283)	0,0505	(1,283)	-	-
1-1/2	(38,10)	0,0555	(1,410)	0,0555	(1,410)	0,062	(1,575)
1-5/8	(41,28)	0,0555	(1,410)	0,0555	(1,410)	-	-
2-1/8	(53,98)	0,0640	(1,626)	0,0640	(1,626)	-	-
2-5/8	(66,68)	0,0740	(1,880)	0,0740	(1,880)	-	-

L'épaisseur nominale de paroi des tubes doit être supérieure à l'épaisseur indiquée pour maintenir l'épaisseur minimale de paroi.

Annexe DD **(informative)**

Exigences relatives aux informations et au marquage des appareils contenant des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES

DD.1 Instructions concernant le marquage, l'installation et le fonctionnement (SB6)

DD.1.1 Généralités

Des exigences supplémentaires relatives aux informations et au marquage s'appliquent aux États-Unis pour les appareils de réfrigération utilisant des FLUIDES FRIGORIGENES INFLAMMABLES. La référence du document source est indiquée entre crochets à la fin de chaque article.

DD.1.2 Marquage

Lorsqu'un FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE est utilisé, les marquages spécifiés de DD.1.3 à DD.1.6 ou équivalents, doivent être

- a) écrits en lettres de 6,4 mm (1/4 pouce) de hauteur au minimum et;
- b) apposés de façon permanente sur les appareils de réfrigération aux emplacements indiqués.

(Annexe SB6.1.1 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 17 novembre 2014)

DD.1.3 Marquages pour L'OPERATEUR

«DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation de fluide frigorigène inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer les appareils de réfrigération. Ne pas percer les tubes frigorifiques.»

Ce marquage doit être apposé sur ou à proximité de tous les évaporateurs susceptibles d'être en contact avec l'utilisateur.

(Annexe SB6.1.2 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 28 juin 2013)

DD.1.4 Marquages d'entretien

Pour les APPAREILS DE REFRIGERATION autonomes, les marquages suivants doivent être situés à proximité du compartiment de la machine. Pour un groupe de condensation distant, les marquages suivants doivent être situés à proximité des raccordements interconnectés des tubes frigorifiques et de la plaque signalétique:

- a) «DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation de fluide frigorigène inflammable. A faire réparer uniquement par le personnel d'entretien qualifié. Ne pas percer les tubes frigorifiques.»
- b) «ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation de fluide frigorigène inflammable. Consulter le manuel de réparation / le guide d'entretien avant de tenter d'installer ou d'entretenir cet appareil. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.»

(Annexe SB6.1.3 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 30 novembre 2012)

DD.1.5 Élimination

«ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer de façon adaptée selon les règlements fédéraux ou locaux. Utilisation de fluide frigorigène inflammable.»

Ce marquage doit être apposé à l'extérieur de l'appareil de réfrigération.

(Annexe SB6 de la 10^e édition de la norme UL 471 publiée le 24 novembre 2010)

DD.1.6 Tubes exposés

«ATTENTION – Tubes frigorifiques percés entraînant un risque d'incendie ou d'explosion. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation de fluide frigorigène inflammable»

Ce marquage doit être apposé à proximité de tous les tubes frigorifiques exposés.

(Annexe SB6 de la 10^e édition de la norme UL 471 publiée le 24 novembre 2010)

DD.1.7 Accès au circuit de fluide frigorigène

Les tubes frigorifiques ou autres dispositifs de transport de fluide frigorigène doivent être peints, comporter des couleurs ou une étiquette rouge, n° 185 du nuancier Pantone® Matching System (PMS). Cette couleur doit figurer à tous les endroits du circuit de fluide frigorigène susceptibles d'être percés ou perforés pendant l'entretien. Dans le cas d'un tube de traitement sur un MOTOCOMPRESSEUR, le marquage de couleur doit dépasser d'au moins 2,5 cm (1 pouce) du motocompresseur.

(Annexe SB6.1.6 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 17 novembre 2014)

DD.1.8 Symbole d'avertissement relatif aux matières inflammables

Le marquage indiqué en DD.1.4 a) doit également comporter le symbole 102 du Tableau 1 d'avertissement relatif aux matières inflammables.

La couleur et le format du symbole doivent être exactement tels que représentés. La hauteur perpendiculaire du triangle doit être d'au moins 15 mm (9/16 pouces).

(Annexe SB6.1.7 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 28 juin 2013)

DD.1.9 Appareils contenant un groupe de condensation distant

Pour les appareils contenant un groupe de condensation distant, le marquage suivant doit être situé à proximité du tube destiné au raccordement du tube frigorifique installé sur place:

«ATTENTION – Cet appareil est destiné à être utilisé avec un fluide frigorigène inflammable. Installer selon les exigences relatives au fluide frigorigène inflammable spécifiées dans la norme ANSI/ASHRAE 15.»

(Annexe SB6 de la 10^e édition de la norme UL 471 publiée le 24 novembre 2010)

DD.1.10 APPAREILS DE REFRIGERATION destinés à une utilisation en laboratoire

Les APPAREILS DE REFRIGERATION destinés à une utilisation en laboratoire contenant un fluide frigorigène A3 doivent porter le marquage suivant:

«Cette unité est destinée à une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle, comme défini dans la norme de sécurité des systèmes frigorifiques, ANSI/ASHRAE 15.»

(Annexe SB6.1.9 de la 10^e édition de la norme UL 471 ajoutée le 30 novembre 2012)

DD.2 Instructions relatives à l'installation et au fonctionnement

DD.2.1 Manipulation et déplacement

Les instructions concernant l'installation et le fonctionnement doivent être fournies, accompagnées d'énoncés de précaution relatifs à la manipulation, au déplacement et à l'utilisation des appareils de réfrigération afin d'éviter d'endommager les tubes frigorifiques ou d'augmenter le RISQUE de fuite.

(Annexe SB6 de la 10^e édition de la norme UL 471 publiée le 24 novembre 2010)

DD.2.2 Marquages sur l'emballage

Le carton d'expédition d'un APPAREIL DE REFRIGERATION utilisant du FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE doit porter le marquage suivant:

«Attention – RISQUE d'incendie ou d'explosion en raison de l'utilisation de fluide frigorigène inflammable. Suivre attentivement les instructions de manipulation conformément aux règlements du gouvernement des États-Unis.»

Le marquage d'avertissement du symbole 102 du Tableau 1 doit également figurer sur le carton d'expédition.

(Annexe SB6.2.2 de la 10^e édition de la norme UL 471 révisée le 17 novembre 2014)

DD.2.3 Composants de remplacement et entretien

Les instructions concernant l'installation et le fonctionnement doivent indiquer que les composants doivent être remplacés par des composants similaires et que l'entretien doit être effectué par le personnel autorisé par le fabricant, afin de réduire le plus possible le RISQUE d'inflammation possible dû à des parties ou à un entretien inadaptés.

DD.2.4 Instructions d'installation pour les appareils contenant un GROUPE DE CONDENSATION distant

En plus des instructions susmentionnées, les instructions d'installation relatives aux appareils contenant un groupe de condensation distant doivent comporter les indications suivantes:

- a) Des informations relatives aux espaces autorisés d'installation des tuyaux contenant du FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE, y compris les énoncés indiquant que (1) les tuyauteries doivent être protégées contre les dommages physiques et que (2) la conformité aux exigences d'installation de la norme ANSI/ASHRAE 15 doit être respectée.
- b) Le volume minimal nécessaire autorisé du local, par charge de SYSTEME FRIGORIFIQUE. Voir le Tableau DD.1. Cette indication peut prendre la forme d'un tableau indiquant les valeurs minimales du volume du local par quantité de charge de fluide frigorigène, mais l'indication ne doit pas contenir de formule.
- c) Des informations relatives à la manipulation, à l'installation, au nettoyage, à l'entretien et à l'élimination du fluide frigorigène.
- d) Un avertissement stipulant que l'appareil ne doit pas être installé dans un local comportant des flammes nues ou des sources d'inflammation fonctionnant de manière continue.

Tableau DD.1 – Quantité de fluide frigorigène du Groupe A2/A3 par local occupé

Numéro du fluide frigorigène	Nom chimique	Formule	Quantité de fluide frigorigène par local occupé ^a		
			lb/ 1 000 ft ³	ppm par volume	g/m ³
R-142b	1-Chloro-1,1,-Difluoroéthane	CH ₃ CClF ₂	3,7	14 000	60
R-152a	1,1,-Difluoroéthane	CH ₃ CHF ₂	1,2	7 000	20
R-170	Éthane	CH ₃ CH ₃	0,50	6 400	8,0
R-290	Propane	C ₃ H ₈	0,50	4 400	8,0
R-600	Butane	C ₄ H ₁₀	0,51	3 400	8,2
R-600A	2-Méthylpropane (Isobutane)	CH(CH ₃) ₃	0,51	3 400	8,2
R-1150	Éthène (Éthylène)	C ₂ H ₄	0,38	5 200	6,0
R-1270	Propène (Propylène)	C ₃ H ₆	0,37	3 400	5,9

NOTE Les appareils énumérés pour une utilisation en laboratoire avec un espace par personne supérieur à 100 ft² (9,3 m²) ne sont pas concernés par cette limite dans la mesure où les appareils sont installés conformément à l'ordre des numéros de fluide frigorigène et aux instructions d'installation du fabricant.

^a Les valeurs des fluides frigorigènes proviennent du Tableau 1 de la norme ANSI/ASHRAE 15-2013.

Bibliographie

La Bibliographie de la Partie 1 est applicable à l'exception de ce qui suit:

Addition:

Ajouter à la liste les publications suivantes:

IEC 60079-20:2010, *Atmosphères explosives – Partie 20: Caractéristiques des substances pour le classement des gaz et des vapeurs*

IEC 60079-20-1, *Atmosphères explosives – Partie 20-1: Caractéristiques des substances pour le classement des gaz et des vapeurs – Méthodes et données d'essai*

ISO 4126-1, *Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives – Partie 1: Soupapes de sûreté*

ISO 4126-2, *Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives – Partie 2: Dispositifs de sûreté à disque de rupture*

ISO 5149 (toutes les parties), *Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d'environnement*

ISO 5149-1:2014, *Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d'environnement – Partie 1: Définitions, classification et critères de choix*

ISO 817, *Fluides frigorigènes – Désignation et classification de sécurité*

ANSI/ASHRAE 15-2013, *Safety Standard for Refrigeration Systems*

ANSI/ASHRAE 34-2013, *Designation and Safety Classification of Refrigerants*

CSA C22.2 No. 120-13, *Refrigeration Equipment*

EN 378-1:2008+A2:2012, *Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d'environnement. Exigences de base, définitions, classification et critères de choix*
EN 378-1:2008/AMD2:2012

EN 378-2:2008, *Refrigerant condensing systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation*
EN 378-2:2008/AMD2:2012

EN 378-3:2008, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Installation site and personal protection*
EN 378-3:2008/AMD1:2012

EN 378-4:2008, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements. Operation, maintenance, repair and recovery*
EN 378-4:2008/AMD1:2012

EN 809:1998, *Pumps and pump units for liquids – Common safety requirements*

EN 1736:2000, *Refrigerating systems and heat pumps – Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints – Requirements, design and installation*

EN 1779:1999, *Non-destructive testing – Leak testing – Criteria for method and technique selection*

EN 12263:1998, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety switching devices for limiting the pressure – Requirements and tests*

EN 12284:2003, *Refrigerating systems and heat pumps – Valves – Requirements, testing and marking*

EN 12693:2006, *Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Positive displacement refrigerant compressors*

EN 13136:2001, *Refrigerating systems and heat pumps – Pressure relief devices and their associated piping – Methods for calculation*

EN 13445-1:2002, *Unfired pressure vessels – Part 1: General*

EN 13445-2:2002, *Unfired pressure vessels – Part 2: Materials*

EN 13445-3:2002, *Unfired pressure vessels – Part 3: Design*

EN 13445-4:2002, *Unfired pressure vessels – Part 4: Fabrication*

EN 13445-5:2002, *Unfired pressure vessels – Part 5: Inspection and testing*

EN 13445-6:2002, *Unfired pressure vessels – Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron*

EN 13445-8:2006, *Unfired pressure vessels – Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys*

EN 14276-1:2006, *Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps – Part 1: Vessels – General requirements*

EN 14276-2:2007, *Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps – Part 2: Piping – General requirements*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch